

Стоматологічна установка

Gallant AMBIDEXTRE

НАСТАНОВА ЩОДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ

UKR_2014_v5



приватне підприємство "ГАЛІТ"

вул. 15 Квітня 6Є, с. Байківці, Тернопільський р-н, 47711, Україна

Тел.: (0352) 43 38 07, Факс: (0352) 43 04 03

E-mail: office@galit.te.ua, www.galit.te.ua

Список редакцій змін

Причина змін

Ред	Дата	Причина зміни
2	23.12.2013	Змінений шильд. Змінений розділ Додаток Б.Перевірка параметрів стоматологічного обладнання.
3	Січень, 2014	Зміна конфігурації установки.
4	14.04.2014	Зміни, пов'язані з покращенням технічних характеристик обладнання.
5	05.2014	Виконання без світильника.

Перелік сторінок змін

№ сторінки / Редакція	Відомості про зміни документу	№ сторінки	Відомості про зміни документу
1,11,42/2	Замінені		
Всі/3	Замінені		
8,12,40/4	Замінені		
Всі/5	Замінені		

Переконайтесь, що використовується остання версія документу.

Щоб отримати дані про останню версію зверніться до дистриб'ютора або на фірму-виробника.

ВСТУП

При купівлі установки переконайтесь в наявності штампу торгового підприємства, дати продажу і підпису продавця в розділі 13 цієї настанови щодо експлуатування та в талонах на гарантійні ремонти. Перевірте комплектність установки згідно розділу 2.3 даної настанови щодо експлуатування.

ПАМ'ЯТАЙТЕ! При відсутності відповідних відміток, гарантійний термін починається з дати виготовлення установки.

Дана настанова щодо експлуатування є невід'ємною частиною Вашої нової стоматологічної установки. Завжди тримайте її недалеко від установки, щоб Ви або Ваш технік змогли швидко і легко звернутися до неї. Прочитайте цю настанову щодо експлуатування і переконайтесь, що Ви повністю її розумієте, перед тим, як приступити до роботи з стоматологічною установкою. Дана настанова щодо експлуатування не може охопити всі аспекти по використанню, але вона може допомогти уникнути помилок при користуванні Вашою стоматологічною установкою.

Інформація, викладена в даній настанові щодо експлуатування, є правильною і новою на час друку. Інформація в настанові щодо експлуатування викладена з метою полегшення роботи зі стоматологічною установкою. Завжди дотримуйтесь рекомендацій, вони допоможуть зробити роботу Вашої установки економічною і ефективною. Наші установки постійно вдосконалюються, покращуються їхні характеристики, оновлюється дизайн, тому рисунки і позначення в цій настанові щодо експлуатування можуть незначно відрізнятися від Вашої установки.

Якщо виникнуть якісь пошкодження, або проблеми при використанні стоматологічної установки, зв'яжіться з відділом сервісного обслуговування підприємства, яке продало Вам установку. При необхідності проведення ремонту використовуйте лише оригінальні запасні частини для того, щоб Ваша стоматологічна установка ефективно працювала протягом всього терміну експлуатації.

Вся продукція випробувана, і на неї дається гарантія терміном на 24 місяців від дати монтажу. Ця гарантія надається всім клієнтам, які виконали контрактні та адміністративні зобов'язання, встановили і використовують стоматологічну установку згідно настанови щодо експлуатування. Відповідно до цієї гарантії ВИРОБНИК ремонтує або безкоштовно замінює всі компоненти, які визнані бракованими з вини виробника, або вийшли з ладу протягом гарантійного періоду.

Служба технічної допомоги ВИРОБНИКА є єдиним органом, який визначає, чи підлягає несправність умовам гарантії. Гарантія не покриває витрат на оплату праці працівників Служби технічної допомоги, які мають бути відшкодовані. Гарантія не враховує відповідальність з боку ВИРОБНИКА за прямі чи непрямі втрати чи пошкодження, заподіяні людям чи предметам як результат неправильного користування чи обслуговування стоматологічної установки при цьому гарантія поширюється тільки на матеріали і монтаж. Більш того, гарантія не враховує витрати, яких зазнає персонал ВИРОБНИКА при перевезенні, огляді, заміні чи повторному монтажу, якщо несправності не є наслідками дефектів матеріалів чи складання. Всі витрати будуть вираховані з користувача.

Класифікація обладнання

Наступні методи класифікації відповідають IEC/EN 60601-1:6.8.1:

- Згідно директиви по медичним приладам 93/42/ ЄЕС стоматологічна установка відповідає класу II а.
- У відповідності з вимогами IEC/EN 60601-1 стоматологічна установка є обладнанням класу I.
- Згідно CISPR 11 стоматологічна установка є обладнанням ISM групи 1, класу B.

Маркування 

Маркування CE



Виріб промарковано знаком відповідності 

Даний виріб відповідає регулятивним вимогам Директиви Європейського союзу 93/42/ЄЕС на медичні вироби.

Про відповідність цієї Директиві свідчить наклейка CE на виробі.

Розташування наклейки CE вказано в розділі 2.1.3 настанови щодо експлуатування.

Відповідність міжнародним стандартам

- EN 1640:1996 *Стоматология - Медицинские устройства для стоматологии – Оборудование*
- IEC/EN 60601-1 *Медицинское электрическое оборудование - Часть 1: Общие требования для основной безопасности и существенной работы*
- IEC/EN 60601-1-1 *Медицинское электрическое оборудование - Часть 1-1: Общие требования для безопасности - Сопутствующий стандарт: требования Безопасности для медицинских электрических систем*
- IEC/EN 60601-1-2 *Медицинское электрическое оборудование - Часть 1-2: Общие требования для основной безопасности и существенной работы - Сопутствующий стандарт: Электромагнитная совместимость - Требования и тесты*
- IEC 60601-1-6:2004 *Медицинское электрическое оборудование - Часть 1-6: Общие требования для основной безопасности и существенной работы - Сопутствующий Стандарт: Удобство и простота использования*
- ISO 10993-1 *Биологическая оценка медицинских приборов.*

Сертифікати

№.: CQ110281-13 DIN ISO 13485: 2010
(EN ISO 13485: 2003 + AC: 2009)

Сервісні представники в Європі: телефони, адреса

В даній настанові щодо експлуатування використані наступні умовні позначення:

**УВАГА!**

Зверніть особливу увагу на пункти, які відзначені цим знаком.
В цих пунктах описані дії, невиконання яких може привести до травм або небезпеки для життя, або викликати пошкодження обладнання, якщо не дотримуватися даної настанови щодо експлуатування.



ВИСОКА НАПРУГА, небезпека удару електричним струмом.



ЗВЕРНУТИСЯ ДО ВІДПОВІДНОЇ ІНСТРУКЦІЇ АБО НАСТАНОВИ ЩОДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ

(Інструкції по використанню, інструкції щодо експлуатації, супроводжуючі документи).



ПРАЦЮВАТИ ТІЛЬКИ З ЗАХИСНИМ УЗЕМЛЕННЯМ.

	стор.
Вступ.....	3
1.1 Умовні позначення	5
1.2 Зміст.....	6
1.3 Заходи безпеки.....	7
2 Опис стоматологічної установки.....	10
2.1 Інформація про виріб.....	10
2.2 Позначення складових частин установки.....	11
2.3 Ідентифікаційний шильд.....	11
2.4 Технічні характеристики.....	12
2.5 Комплект поставки.....	13
3 Вимоги до зовнішніх комунікаційних систем.....	14
4 Ввімкнення установки.....	15
4.1 Перевірка установки перед початком роботи.....	15
5 Блок інструментів лікаря.....	16
5.1 Пульти керування блоку лікаря.....	16
5.2 Регулювання робочих режимів інструментів на блоці лікаря.....	18
5.2.1 3-х функційний стоматологічний пістолет.....	20
5.2.2 Пневматична турбіна.....	21
5.2.3 Електричний мікромотор.....	23
5.2.4 П'єзоелектричний скелер.....	24
5.3 Варіант виконання стоматологічної установки "Gallant AMBIDEXTRE" з опцією ЕНДО.....	25
5.3.1 Настроювання частоти обертання мікромотора на II - IV робочому місці в нормальному режимі	27
5.3.2 Настроювання частоти обертання мікромотора в режимі ЕНДО.....	28
5.3.3 Настроювання крутного моменту мікромотора на III робочому місці в режимі ЕНДО.....	29
6 Блок інструментів асистента.....	30
7 Плювальниця на поворотному важелі.....	31
7.1 Функції наповнення склянки і змиву плювальниці.....	31
7.2 Система чистої води.....	31
8 Обслуговування.....	32
8.1 Очистка і дезінфекція установки.....	32
8.2 Догляд за інструментами.....	33
8.3 Очистка фільтра плювальниці.....	34
8.4 Злив конденсату з установки.....	34
8.5 Очистка фільтра відпрацьованого повітря пневмовиходів.....	35
8.6 Фільтр грубої очистки.....	35
8.7 Обслуговування аспірації блоку асистента.....	36
8.8 Заміна запобіжників	37
9 Рекомендована періодичність обслуговування.....	38
10 Технічні несправності і методи їх усунення.....	38
11 Електромагнітна сумісність (ЕМС) (МЕК 60601-1-2).....	39
12 Утилізація.....	43
Додаток А. Перевірка параметрів стоматологічного обладнання.....	44
Додаток Б. Рекомендований план підводу комунікацій "під крісло" для стоматологічної установки "Gallant-AMBIDEXTRE" з кріслом STING.....	46
13 Загальні умови гарантії.....	47

Щодо безпеки виріб відповідає вимогами IEC/EN 60601-1 і є обладнанням класу I типу B.



- Установка повинна під'єднуватись до мережі з захисним уземленням;
- Категорично забороняється експлуатація стоматологічного обладнання (крісла стоматологічного, світильника, установки стоматологічної) без надійного уземлення;
- Категорично забороняється проводити усунення несправностей в установці, під'єднаної до електромережі;
- Заборонено користування установкою особам, які докладно не ознайомились з даною настановою щодо експлуатування;
- Завжди виконуйте вказівки настанови щодо експлуатування стосовно вірного користування установкою;
- Не користуйтесь установкою при виявленні ознак пошкоджень. У випадку неполадок викличте авторизованого технічного працівника;
- Заміну пошкоджених деталей і компонентів виконувати тільки оригінальними запасними частинами, дозволеними для заміни фірмою ГАЛІТ;
- Завжди після завершення роботи вимкнути головний вимикач мережі установки.

Загальні вказівки по техніці безпеки

Використання за призначенням

Дана стоматологічна установка використовується для терапії, діагностики і лікування зубів персоналом, який пройшов навчання.

Даний виріб не призначений для експлуатації у вибухонебезпечних приміщеннях.

Монтаж, який виконує користувач по місцю

Монтаж установки повинен бути виконаний згідно вимог підприємства-виробника. Детальний опис представлений в інструкції з монтажу.

Догляд і ремонт

Як виробник стоматологічного обладнання для забезпечення експлуатаційної надійності і безпеки роботи виробу ми надаємо величезного значення тому, щоб **технічне обслуговування і ремонт** виконувалися тільки нами або персоналом, який одержав від нас на це виключне право, а при виході з ладу деталей, що впливають на безпеку роботи виробу, вони замінювались тільки на **оригінальні запасні частини**.

Ми рекомендуємо Вам при проведенні подібних робіт отримати від виробника документ з вказівкою виду й обсягу робіт, при необхідності, з інформацією про зміну номінальних параметрів або робочого діапазону, і, крім того, з датою, інформацією про фірму-виробника і підписом.

Зміни виробу

Зміни в цьому виробі, що можуть вплинути на безпеку користувача, пацієнта або інших осіб, відповідно до законодавства категорично заборонені!

Для забезпечення експлуатаційної надійності і безпеки даний виріб дозволяється експлуатувати тільки з оригінальними комплектуючими виробництва фірми Галіт або з комплектуючими інших виробників, дозволених фірмою Галіт. Усю відповідальність за використання недозволених комплектуючих (деталей) несе користувач.

Якщо підключаються вироби, недозволені фірмою Галіт, вони повинні відповідати діючим нормам:

IEC 60950 для систем обробки і передачі даних (наприклад, ПК), а також IEC 60601-1 для медико-технічного обладнання.

Комбінування з іншими приладами

При підключенні установки до іншого обладнання (наприклад, ПК), а також зміні електричної системи користувач несе відповідальність за те, щоб у повному обсязі виконувалися вимоги стандарту IEC 60601-1-1 (Положення про безпечну експлуатацію медичних електричних систем), які стосуються безпеки пацієнтів, обслуговуючого персоналу та навколишнього середовища.

У разі сумнівів зверніться до виробника стоматологічної установки.

Електромагнітна сумісність (ЕМС)

Стоматологічна установка "Gallant AMBIDEXTRE" відповідає вимогам стандарту IEC 60601-1-2:2001.

Стоматологічна установка "Gallant AMBIDEXTRE" відповідає вимогам електромагнітної сумісності групи 1 класу В згідно ДСТУ CISPR 11:2007.

- **Група 1** – медичне обладнання, в якому умисно генеруються або використовуються енергія радіочастот з кондуктивним зв'язком, необхідним для внутрішнього функціонування самого обладнання.
- **Обладнання класу В** – це обладнання, придатне для побутового застосування, та установок, які безпосередньо підключено до низьковольтної мережі електроживлення, що живить будівлі, які застосовують із побутовою метою.

Обладнання класу В повинно відповідати нормам для класу В.

Електромагнітна сумісність (ЕМС)

Медичне електричне обладнання повинно відповідати всім вимогам безпеки щодо забезпечення ЕМС.

Обладнання повинно встановлюватися й експлуатуватися відповідно до вказівок, приведених у документі „Електромагнітна сумісність (ЕМС) (МЕК 60601-1-2). Переносні і мобільні засоби ВЧ-зв'язку можуть впливати на електро-медичне обладнання.
Необхідно заборонити користуватись радіотелефонами на території клінік і лікарських практик.

Якість води/повітря, які подаються

Подача повітря і води повинна відповідати вимогам, зазначеним в інструкції. Використовуйте тільки чисту воду.

Вимоги до характеристики води

Користувач стоматологічної установки несе відповідальність за якість води, яка подається і при необхідності повинен вживати альтернативних заходів по дотриманні вимог до води.

Система відсмоктування

Відсмоктування оксидів алюмінію або інших металів зі струменевих апаратів через вбудовану в стоматологічну установку сепараційну автоматику і амальгамо-відділювач заборонено! Це приводить до екстремального зносу і закупорки всмоктувальних і відповідних воду каналів.
При використанні метало - оксидних струменевих апаратів повинен застосовуватися окремий відсмоктувач.
Стоматологічні установки з центральним мокрим відсмоктуванням принципово підходять для відсмоктування вищеназваних матеріалів. Чітко дотримуйтесь вказівок виробника Вашої відсмоктувальної системи.
Для застосування струменевих апаратів в поєднанні зі стоматологічними установками немає ніяких обмежень. Але в кінці роботи потрібно забезпечити достатню промивку водою.

Стоматологічне крісло

Враховуйте максимальне навантаження на стоматологічне крісло, яке рівне 135кг згідно EN ISO 6875
(випробувано з чотирикратним запасом міцності)

Технічне обслуговування стоматологічної установки

Для забезпечення нормального функціонування установки, потрібно проводити з встановленою періодичністю регулярне технічне обслуговування, профілактичні роботи для забезпечення експлуатаційної надійності і безпеки роботи.

З метою забезпечення експлуатаційної безпеки і придатності стоматологічної установки, запобігання збитку, спричиненого природним зносом, потрібно регулярно проводити перевірку установки співробітниками фірми по технічному забезпеченню. Крім того, повинний виконуватися контроль техніки безпеки. Будь ласка, зверніться за пропозицією по технічному обслуговуванню у сервісний центр фірми-виробника.

Демонтаж і повторний монтаж

При демонтажі і повторному монтажі виробу потрібно виконувати вказівки, які наведені в інструкції з монтажу, щоб забезпечити роботоздатність і стійкість виробу.

Утилізація



Згідно директиви 2002/96/ЕС для запобігання забруднення навколишнього середовища та травм при утилізації дотримуйтеся законів про утилізацію.

Рекомендації про утилізацію описані в розділі 10.

Стоматологічна установка “Gallant AMBIDEXTRE” складається з: крісла пацієнта STING, блока лікаря на поворотному важелі, блоку плювальниці на поворотному важелі і блока асистента DURR COMFORT на поворотному важелі.

Для функціонування стоматологічної установки необхідна наявність: системи відсмоктування і каналізації.

Функціонально на стоматологічній установці можна виконувати такі операції:

- керування пилевідсмоктувачем;
- керування слиновідсмоктувачем;
- керування рухом крісла;
- регулювання частоти обертання мікромотора від 3700 до 42 000 об/хв. в нормальному режимі і від 550 об/хв до 2900 об/хв в режимі ЕНДО;
- створення обертового руху пневмотурбіни з частотою обертання до 310 тис. об/хв;
- подачу рідини з системи “чистої води” до багатофункційного стоматологічного пістолета;
- регулювання потужності скелера при частоті вібрації в діапазоні (22-30) кГц;
- наповнення склянки;
- змив чаші плювальниці.

Функціональні можливості стоматологічних установок встановлюються окремо для кожного виробу в залежності від замовлення, в тому числі від додаткових потреб конкретного споживача.

Проте є мінімальний перелік функцій, які повинна виконувати будь-яка установка.

2.1. Інформація про виріб

Застосування за призначенням

Стоматологічна установка (надалі по тексту - установка) призначена для надання стоматологічної допомоги в умовах поліклінік, лікарень і інших лікувальних закладів.

Область використання установок - лікувальна і ортопедична стоматологія.

Монтаж в медичних закладах:

При розробці і виготовленні стоматологічної установки були враховані всі спеціальні вимоги до продукції медичного призначення. При встановленні обладнання в медичних закладах під час механічного і електричного монтажу необхідно дотримуватись вимог **директиви 93/42 ЕЕС** на медичні вироби, стандартів **ІЕС 60601-1, ІЕС 60601-1-1, ІЕС 60601-1-2**.

Застосування не за призначенням

Будь-яке інше, не передбачене даною настановою щодо експлуатування, використання виробу рахується використанням не за призначенням. За причинену внаслідок цього шкоду виробник відповідальності не несе. Всі ризики в цьому випадку несе користувач.

2.2. Позначення складових частин установки



Рисунок 2.2.1 Стоматологічна установка "Gallant AMBIDEXTRE".

2.3. Ідентифікаційний шильд

Ідентифікаційний шильд з написом загальних даних розміщений на важелі блоку асистента (Рисунок 2.1.3.1).

Серійний номер (SN): **XXXX MM YY**

XXXX - № установки

MM – місяць виготовлення

YY – рік виготовлення

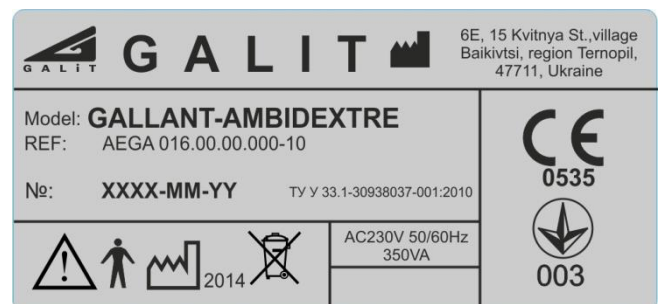


Рисунок 2.3.1

Коли Ви звертаєтесь з проханням про надання Вам інформації, послуг чи запасних частин, завжди вказуйте модель, тип і серійний номер Вашої стоматологічної установки. Ця інформація вказана в гарантійному талоні на стоматологічну установку.

Напруга живлення	220 В, 50 Гц
Тиск мережі водопостачання	3-4 кг/см ²
Споживання води	До 10 л/хв*
Тиск мережі стисненого повітря	5,5-8 кг/см ²
Споживання стисненого повітря	30-70 л/хв*
Максимальний струм споживання	5А
Середня споживана потужність:	
блоку лікаря	140 ВА
крісла	850 ВА
в режимі очікування	20 ВА
в робочому режимі	200 ВА
Максимальна споживана потужність	1100 ВА
Вага	80-350 кг*

*Примітка в залежності від комплектації установки.

Умови транспортування і зберігання	Температура навколишнього середовища:	-40°C – +70°C
	Відносна вологість повітря:	10% – 100%
	Атмосферний тиск:	500 – 1060 гПа
Умови експлуатації	Температура навколишнього середовища:	+10°C – + 40°C
	Відносна вологість повітря:	30% – 75%
	Атмосферний тиск:	700–1060 гПа
Клас захисту	Виріб класу захисту I	
Ступінь захисту від ураження електричним струмом:	Користувальна частина типу В	
Ступінь захисту від попадання води згідно IEC 60529 (стоматологічна установка)	IPX0 Звичайний виріб (захист відсутній)	
Ступінь захисту від попадання води згідно IEC 60529 (педаль)	IPX1	
Режим роботи	Безперервний режим з повторно-короткочасним навантаженням відповідно до роботи стоматолога.	
	Стационарно встановлений виріб.	
Рік виготовлення		(на ідентифікаційному шильді установки) 20XX

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.5

1	Установка стоматологічна "Gallant AMBIDEXTRE"	SN:	1 шт.	☐
2	Настанова щодо експлуатування стоматологічної установки "Gallant AMBIDEXTRE"		1 шт.	☐
3	Інструкція з монтажу стоматологічної установки "Gallant AMBIDEXTRE"		1 шт.	☐
4	Блок асистента Durr Comfort		1 шт.	☐
5	Настанова щодо експлуатування Durr Comfort		1 шт.	☐
6	Комплект монтажних частин (знаходиться в ящику монтажних і запасних частин).		1 шт.	☐
7	Крісло пацієнта STING		1 шт.	☐
8	Настанова щодо експлуатування крісла пацієнта STING		1 шт.	☐
9	Світильник EDI / RHA/MAIA/ALYA		1 шт.	☐
10	Настанова щодо експлуатування світильника		1 шт.	☐
11	Педаль керування		1 шт.	☐
12	Приналежності, які входять в склад установки з відповідними настановами щодо експлуатування. Вказати модель.	SN:		
	1) мікро мотор		1 шт.	☐
	2) мікро мотор		1 шт.	☐
	3) мікро мотор		1 шт.	☐
	4) пістолет		1 шт.	☐
	5) фотополімерна лампа		1 шт.	☐
	6) скелер		1 шт.	☐
	7)			☐
	8)			☐
	9)			☐
13	Комплект сертифікатів і свідоцтв		1 шт.	☐



Виробник не несе відповідальності за пошкодження чи невідповідність технічних характеристик обладнання при недотриманні наступних вимог до зовнішніх комунікаційних систем.

Вимоги до зовнішніх комунікаційних систем

Мережа водопостачання:

- Якість води – питна вода.
- Жорсткість води - 1,5 - 2,14 ммоль/л = 8,4 - 12 dH.
- Рівень рН - від 7,2 до 7,8.
- Вода повинна бути із середнім / низьким вмістом солей (при необхідності встановити пристрій пом'якшення води). Тиск в мережі водопостачання повинен бути в межах 3÷4 bar. У разі перевищення тиску води в мережі водопостачання 6÷8Bar необхідно встановити додатковий редуктор.
- Фільтрація води, яка забезпечується стороною, яка виконує будівельні (монтажні) роботи - 80 мкм.
- Для запобігання попадання води з установки в мережу водопостачання на установці повинен бути зворотний клапан.
- Мережа водопостачання в місці під'єднання до установки повинна закінчуватись різьбовим з'єднанням 1/2" або штуцером, розрахованим на під'єднання шлангу подачі води в установку Ø 6x8 мм. Перед підключенням води злити іржаву воду з мережі водопостачання.

Стиснене повітря:

- **Стиснене повітря без масляних добавок** і бажано осушене. Осушене повітря продовжує термін експлуатації пневмоінструментів.
- Мінімальний тиск 5,5 bar; Максимальний тиск 8 bar. Шланг стисненого повітря в місці під'єднання до установки повинен закінчуватись внутрішньою різьбою 1/2", або штуцером, розрахованим на під'єднання шлангу Ø 6x8 мм.
- Фільтрація повітря, яка забезпечується замовником - 50 мкм.
- Нижній тиск відсмоктування – статичне на вході в апарат: макс. 180 мбар, динамічне: > 45 мбар, рекомендоване : 60 мбар.
- Приблизна продуктивність відсмоктування – 500 норм. л/хв.

Злив:

- Труба з внутрішнім Ø 50 (або 40) мм з нахилом 8 градусів.
- Рекомендована висота закінчення патрубку над рівнем підлоги не більше 50 мм.



- При використанні пластикових труб для підводу комунікацій використовувати тільки поліпропіленові труби марки НТ, DIN V 19560 (з червоним маркуванням) з 2-манжетними ущільнювачами або аналогічні труби.
- Для підводу комунікацій не використовувати стабілізовані труби НТ, DIN 19561 (з жовтим маркуванням, легко займаються). Вони виготовлені з АБС – пластика / або ASA і нестійкі до меканічних і розчинів, що застосовуються в стоматології.

Головний вимикач установки
(~220 В, 50 Гц).



Рисунок 4.1

- Під'єднати вилку кабелю живлення крісла в розетку електромережі (~220 В, 50 Гц) з контактом заземлення;
- Ввімкнути головний вимикач на кріслі пацієнта. Світловий індикатор цього вимикача сигналізує про включення живлення;

4.1. Перевірка установки перед початком роботи

4.1.1. Перевірити функціонування наповнення склянки і змиву чаші:

- при короткочасному натисненні **кнопки наповнення склянки**  на пульті блоку інструментів лікаря - вода поступає в склянку протягом 3 сек. При повторному натисненні кнопки пульта керування раніше 3 сек. подача води в склянку припиняється;
- при короткочасному натисненні **кнопки змиву чаші**  на пульті блоку інструментів лікаря, (Рисунок 5.1.1) – здійснюється змив чаші на протязі (10-12) сек. При повторному натисненні кнопки пульта керування раніше (10-12) сек. змив чаші припиняється.

4.1.2. Перевірити роботу слиновідсмоктувача: слиновідсмоктувач починає працювати після зняття з тримача;

4.1.3. Перевірити роботу пиловідсмоктувача: пиловідсмоктувач починає працювати після зняття з тримача;

4.1.4. Перевірити функціонування інструментів блоку лікаря (див. розділ 5 Інструкції): для пневматичних інструментів та інструментів з охолодженням відрегулювати додаткові робочі тиски і потоки водоповітряних сумішей охолодження;

4.1.5. Провести контроль роботи системи високошвидкісного відсмоктування - відсмоктуючий агрегат повинен запускатись після зняття шлангу відсмоктування з тримача і зупинятись після вкладання шланга в тримач пульта асистента.

В залежності від замовлення, блок інструментів лікаря на поворотному важелі може бути з верхнім або нижнім розміщенням шлангів з можливістю встановлення 5-ти різних інструментів. В стандартному виконанні блок інструментів лікаря оснащений:

- 3-х функційним стоматологічним пістолетом DSI;
- електричним мікромотором MC2 (BIEN AIR);
- одним турбінним пневмовиходом для під'єднання турбінного наконечника;
- пультом керування роботою інструментів і функціями крісла пацієнта;
- негатоскопом.

ПУЛЬТИ КЕРУВАННЯ БЛОКУ ЛІКАРЯ

5.1

При виконанні стоматологічної установки з опцією ЕНДО на блоці лікаря встановлюється пульт керування з індикатором потужності згідно Рисунок 5.1.1.



Рисунок 5.1.1.: Пульт керування блоку лікаря

5.1.2. Пульт керування кріслом пацієнта

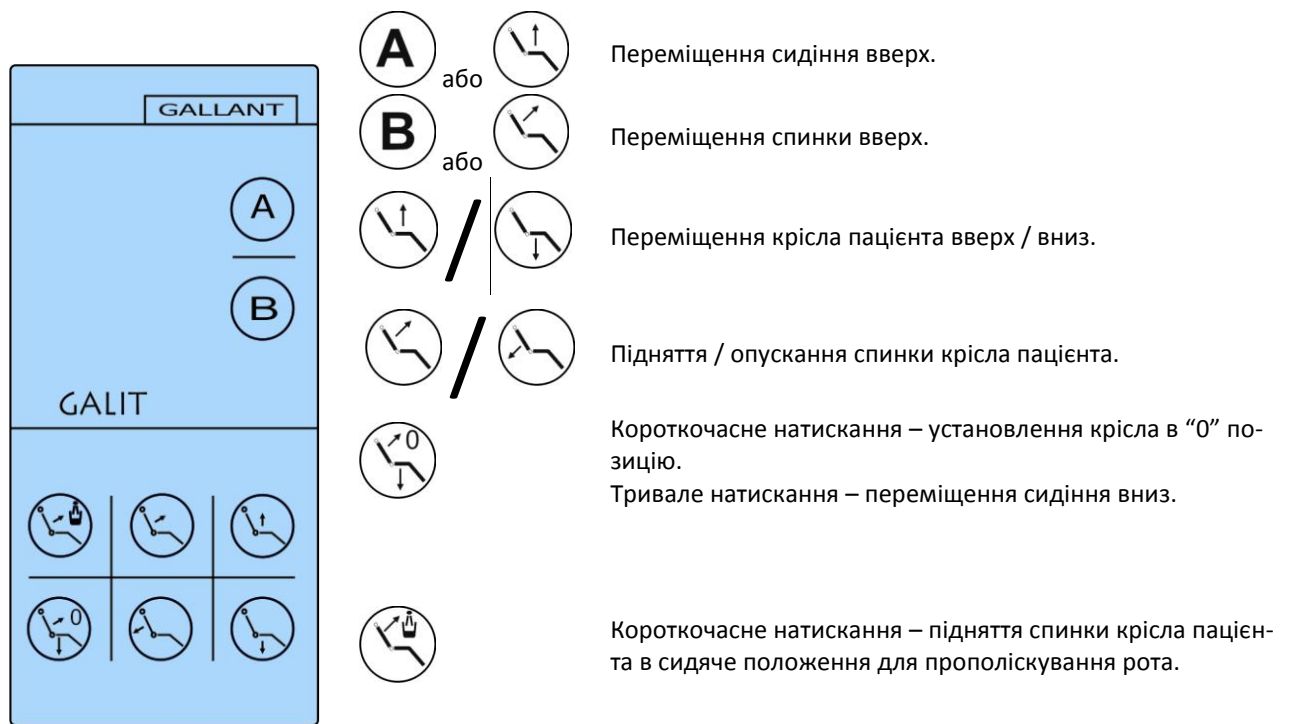


Рисунок 5.1.2.



В розділі 5.2. “Регулювання робочих режимів інструментів на блоці лікаря” описані тільки загальні правила користування робочими інструментами і загальні правила регулювання цих інструментів.



Детальні вказівки щодо роботи і обслуговування робочих інструментів, а також комплект поставки, вказані в експлуатаційній документації на ці інструменти.

Інструменти, крім стоматологічного пістолета і деяких моделей фотополімерних ламп, керуються пневматичною педаллю через плату мікроконтролера, яка знаходиться в блоці лікаря.

Мікроконтролер керує вмиканням / вимиканням інструментів, обертотворним рухом мікромотора в нормальному режимі і режимі ENDO, подачею спрею та підсвіткою, роботою діатермокоагулятора і скелера, якщо такі є в блоці лікаря.

Внутрішнє програмне забезпечення мікроконтролера зорієнтоване на будь-якого замовника з довільним набором інструментів і їх розміщенням на блоці лікаря. Зокрема, мікромотори можна розмістити на другому, третьому або четвертому робочому місці з максимально допустимою напругою живлення з ряду 24V, 30V. Також можна розмістити скелери різних виробників з неоднаковими вимогами щодо регулювання вихідної потужності, та інше.

Відповідність між внутрішнім програмним забезпеченням мікроконтролера та набором інструментів і їх розміщенням встановлюється при замовленні стоматологічної установки і виконується лише на підприємстві “Галіт”.

Всі оперативні кінцеві установки рівня потужності, частоти обертання, індикації, які виконує лікар в ході роботи, зберігаються в пам’яті мікроконтролера. При повторному вмиканні живлення всі останні установки зберігаються.

Система пріоритетного вибору інструментів запобігає одночасній роботі декількох інструментів. Керування здійснюється першим знятим інструментом.

Пневматична педаль дає можливість здійснити головний пуск пневмоінструментів і регулювання їх швидкості.



УВАГА! Перед зняттям інструменту з блоку лікаря переконайтесь, що педаль керування інструментами не натиснена - інакше інструмент почне працювати автоматично і може спричинити травмування персоналу.

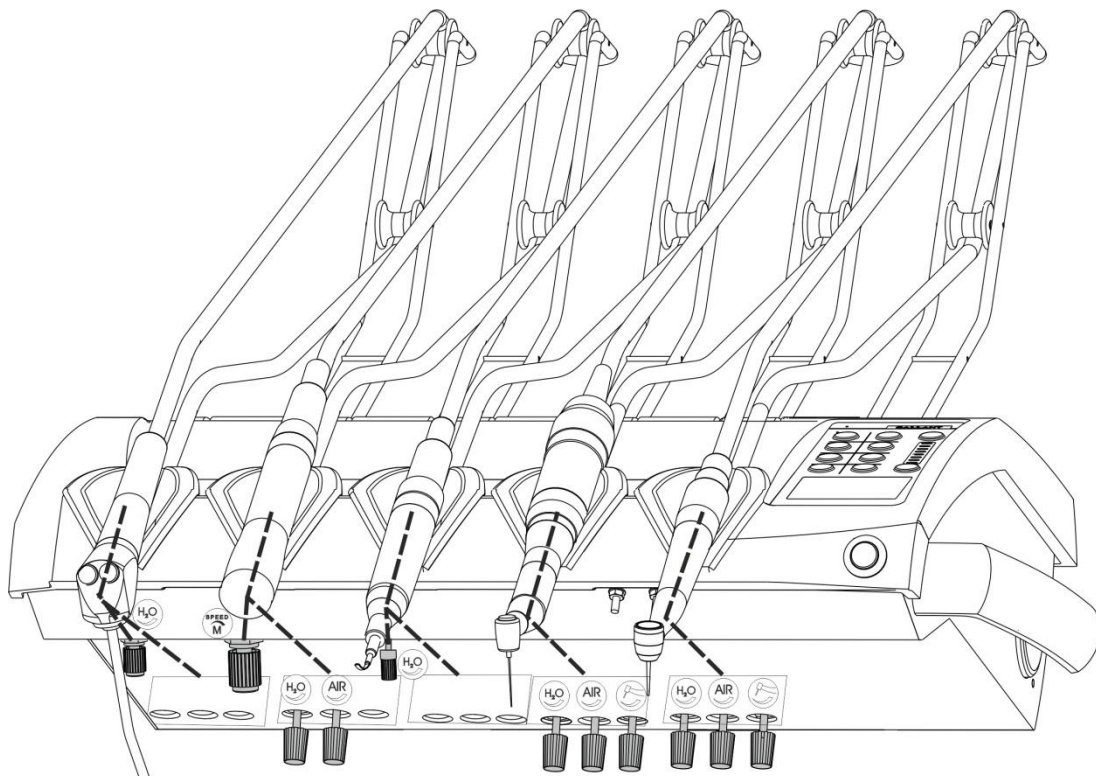


Рисунок 5.2.1. Розміщення органів регулювання робочих інструментів на блоці лікаря.

Регулювання робочих режимів інструментів здійснюється за допомогою органів регулювання, які знаходяться під блоком лікаря (знизу). Для кожного інструменту є свій блок регулювань, який знаходиться під відповідним інструментом. Оперативні регулювання знаходяться на одній осі з інструментом.

В таблиці 5.2.1 наведені варіанти блоків регулювань робочих інструментів.

Таблиця 5.2.1.

Маркування	Блок регулювання пневмоходу №1	Блок регулювання пневмоходу №2	Блок регулювання електричного мікромотора Bien Air	Блок регулювання скелера MECTRON	Блок регулювання 3-х функційного пістолету
	робочий тиск (2,5 ±0,3 bar) *	робочий тиск (2,5 ±0,3 bar) *	X	X	X
	потік повітря у водоповітряній суміші охолодження	потік повітря у водоповітряній суміші охолодження	потік повітря у водоповітряній суміші охолодження	X	X
	потік води у водоповітряній суміші охолодження	потік води у водоповітряній суміші охолодження	потік води для охолодження	потік води	потік води
	X	X	обороти електричного мікромотора	потужність скелера регулюється кнопками на пульті блоку лікаря	X
ENDO/ PERIO/ SCALING	X	X	X	перемикач режимів роботи	X

***Примітки:**

робочий тиск для пневмотурбіни встановлюється по манометру згідно технічних вимог на конкретну модель турбіни.

5.2.1. 3-х функційний стоматологічний пістолет

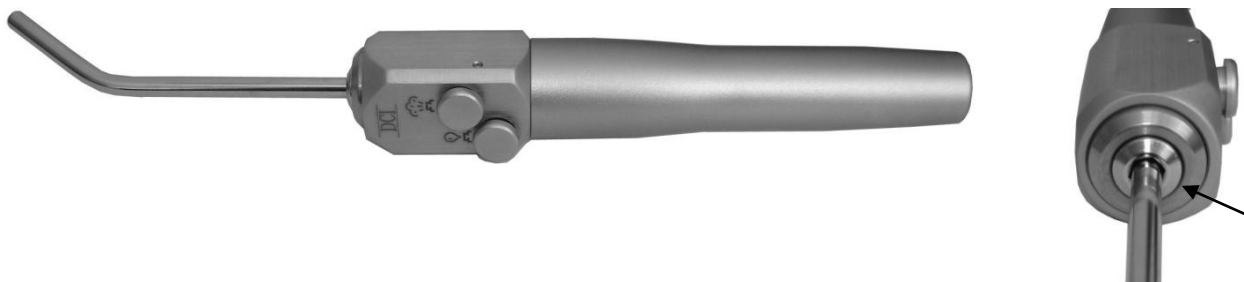


Рисунок 5.2.1.1.

5.2.1.1. Порядок роботи пістолета:

- Зняти пістолет з блоку інструментів;
- Для отримання **води** натиснути ліву кнопку на корпусі пістолету. Для отримання **повітря** натиснути праву кнопку на корпусі пістолету. Для отримання **водо-повітряної суміші (спрей)** натиснути одночасно дві кнопки на корпусі пістолету;
- Щоб змінити кут нахилу носика, повернути носик пістолета в необхідне положення.

5.2.1.2. Режим роботи стоматологічного пістолету - повторно-короткочасний.

5.2.1.3. Обслуговування пістолета:

Очистку носика пістолету проводити мандреном з комплекту поставки.

Дезинфекцію зовнішніх поверхонь, кнопок, корпусу, проводити м'якою тканиною, змоченою дезінфікуючим розчином.

Стерилізацію носика пістолету проводити в автоклаві при температурі $+135^{\circ}\text{C}$ на протязі 20 хвилин. Щоб зняти, а потім встановити носик в корпус пістолету необхідно натиснути на кільце згідно Рисунок 5.2.1.1.



Детальні вказівки щодо роботи і обслуговування стоматологічного пістолета і комплект поставки подані в експлуатаційній документації на пістолет.

5.2.2. Пневматична турбіна

5.2.2.1. Пневмовихід установки має чотириохканальний шланг із з'єднанням до турбіни, пневмомотора або пневмоскелера.



Рисунок 5.2.2.1

5.2.2.2. Підготовка до роботи:

Під'єднати турбіну **1** до пневмовиходу **2** і закрутити гайку **3**.



УВАГА! Категорично забороняється ввімкнення турбіни без встановленого в наконечник інструменту!

5.2.2.3. Порядок роботи турбіни:

- Робочий тиск встановлюється ручкою  на блоці регулювань пневмовиходу за показниками манометра. Робочий тиск для пневмотурбіни встановлюється згідно технічних вимог на конкретну модель турбіни;
- Пропорція водоповітряної суміші для охолодження інструменту виставляється регуляторами  і  блоку регулювань пневмовиходу;
- Зняти турбіну з блоку інструментів лікаря і натиснути педаль керування.

5.2.2.4. Режим роботи турбіни у відповідності з експлуатаційною документацією.



УВАГА! Періодично і після заміни пневматичних інструментів здійснювати контроль робочого тиску. Манометр на блоці лікаря не є засобом вимірювання він виконує функції індикатора.



Рисунок 5.2.2.2

5.2.2.5. Обслуговування турбіни:



УВАГА! Довговічність роботи турбінних наконечників залежить від виконання вимог змазки, а також від дотримання рекомендованого робочого тиску.



Детальні вказівки щодо роботи і обслуговування пневматичної турбіни і комплект поставки подані в експлуатаційній документації на турбіну.

УВАГА!

5.2.2.6. В даному виконанні стоматологічної установки “Gallant AMBIDEXTRE” для пневмовиходу на першій позиції (справа) встановлений пропорційний клапан.

При повністю відкритому пропорційному клапані необхідно забезпечити максимальний тиск на задній стороні турбіни, який не повинен перевищувати значення згідно паспорта.

5.2.2.7. Порядок регулювання тиску турбіни:

- під'єднайте контрольний манометр згідно рисунка 5.2.2.7.1;
- зніміть інструмент;
- натисніть педаль і встановіть важіль педалі в крайнє праве положення, що відповідає максимальній частоті обертання турбіни.

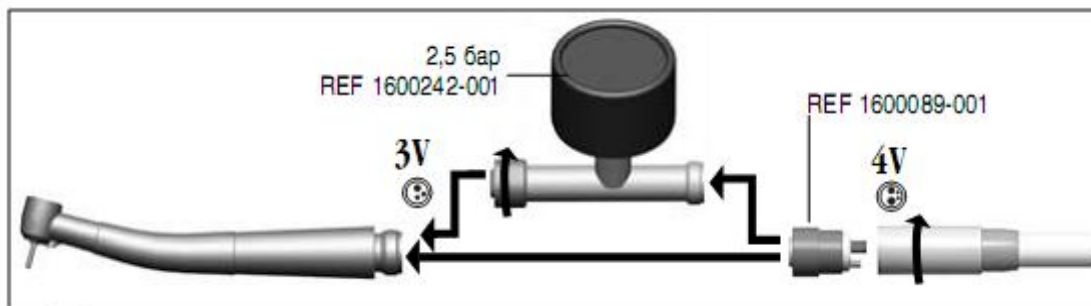


Рисунок 5.2.2.7.1.

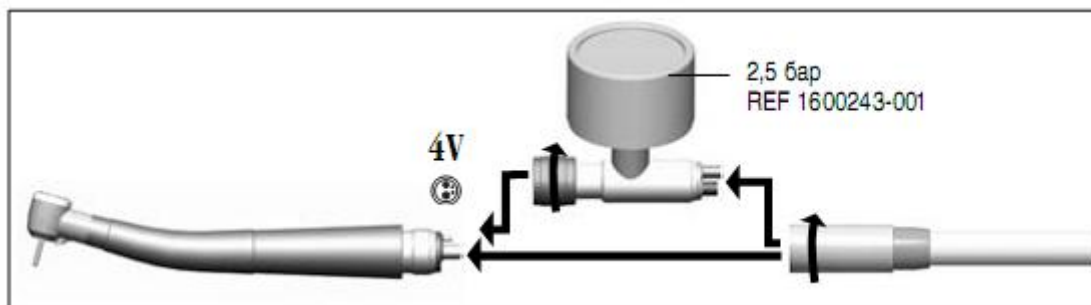


Рисунок 5.2.2.7.2.

Рисунок 5.2.2.7.1. і Рисунок 5.2.2.7.2. — Схеми підключення контрольного манометра.

За допомогою відповідного регулятора потоку (знизу блока лікаря) встановіть максимально допустимий тиск для турбіни яка використовується.

***ПРИМІТКА.** Допускається контролювати тиск турбіни по манометру блока лікаря. Похибка вимірювання при цьому за рахунок довжини шланга не перевищує 0,3 бар.

5.2.3. Електричний мікромотор



УВАГА! Категорично забороняється включати електричний мікромотор без встановленого в наконечник інструменту!

5.2.3.1 Для запуску мікромотора зніміть інструмент з тримача і натисніть педаль керування. Мікромотор буде обертатись за годинниковою стрілкою.

Швидкість обертання мікромотора встановлюється регулятором швидкості  блоку регулювання електричного мікромотора (Таблиця 5.2.1.) або повзунком багатофункційної педалі.

5.2.3.2 Щоб змінити напрямок обертання, відпустіть педаль, а потім натисніть кнопку включення реверсу  на пульті керування блоку лікаря.



УВАГА! Зміна напрямку обертання проводиться тільки під час повної зупинки інструменту.

5.2.3.3 В мікромоторах з подачею водоповітряної суміші для охолодження пропорція водоповітряної суміші ви-
ставляється регуляторами  і  блоку регулювань електричного мікромотора.

Для мікромоторів з підсвіткою – вмикати підсвітку кнопкою ввімкнення підсвітки інструментів  на пульті керування блоку лікаря.

Для забезпечення надійної роботи мікромотора використовувати тільки сухе стиснуте повітря.



Детальні вказівки щодо роботи і обслуговування електричного мікромотора і комплект поставки наведені в експлуатаційній документації на мікромотор.

5.2.4. П'єзоелектричний скелер



Скелер фірми
"SATELEC"

Рисунок 5.2.4.1.

5.2.4.1. Підготовка до роботи:
під'єднати наконечник до роз'єму шланга.



УВАГА! Наконечник фіксується простим затисканням. Категорично забороняється вкручувати наконечник в роз'єм.

5.2.4.2. Порядок роботи скелера:

- Встановити необхідну насадку в залежності від операції, яка буде проводитись. Насадку А закріпити за допомогою динамометричного ключа В, який входить в комплект поставки скелера. Повернути динамометричний ключ разом з насадкою за годинниковою стрілкою впритул до корпусу скелера згідно Рисунок 5.2.4.2.



Рисунок 5.2.4.2.

- Зняти скелер з блоку лікаря.
- Кнопками ,  на блоці лікаря встановити необхідну потужність для вибраної операції.
- Вибрати необхідний режим роботи перемикачем ENDO/PERIO/SCALING для скелера "SATELEC".
- За необхідністю відрегулювати ручкою  інтенсивність подачі води для інструменту.
- Натиснути педаль керування.



УВАГА! Під час запуску скелера в момент натискання педалі категорично забороняється прикладати будь-які зусилля до наконечника скелера. Недотримання цієї вимоги може призвести до пошкоджень наконечника.



Детальні вказівки щодо роботи і обслуговування п'єзоелектричного скелера і комплект поставки подані в експлуатаційній документації на скелер.

5.3

Варіант виконання стоматологічної установки “Gallant AMBIDEXTRE” з опцією ЕНДО.

Стоматологічна установка “Gallant AMBIDEXTRE” з опцією ЕНДО має більш розширені функціональні можливості в порівнянні з іншими виконаннями і призначена, перш за все, для роботи в області ендодонтії. Додатковими є наступні функції (до основних в стандартному виконанні):

- 1) плавне і ступінчате регулювання частоти обертання мікромотора в нормальному режимі.
Максимальне значення частоти обертання по градаціям для даного режиму подано в таблиці 5.3.1;
- 2) плавне і ступінчате регулювання частоти обертання мікромотора в режимі ЕНДО.
Максимальне значення частоти обертання по градаціям для даного режиму подано в таблиці 5.3.1;

Таблиця 5.3.1. Вимірювання максимальної частоти обертання мікромотора MC2, “Bien Air”, в нормальному режимі і в режимі ЕНДО.

Градації	Обороти /хв, ±20% приблизні	
	Нормальний режим	Режим ЕНДО
0	-	550*
I	3700	870*
II	8700	1200*
III	14300	1450*
IV	19700	1630*
V	25050	2100*
VI	30700	2250*
VII	36200	2500*
VIII	42000	2900*

*- Довідкові дані.

- 3) оперативний вибір крутного моменту прямого руху, при якому зупиняється мікромотор і перемикається у реверсивний рух. Можливим є вибір одного з восьми фіксованих значень крутного моменту згідно Таблиці 5.3.2. Дана функція може використовуватись тільки в режимі ЕНДО;

Таблиця 5.3.2 Вибір максимального крутного моменту для колекторних мікромоторів MC2, ISOLITE, MC3 “Bien Air” в режимі ЕНДО.

Градації	Крутний момент, Н·см
I	0,3
II	0,6
III	0,9
IV	1,2
V	1,5
VI	1,8
VII	2,1
VIII	2,3

- 4) наявність додатнього зворотнього зв'язку в схемі керування мікромотором. Схема керування побудована на основі цифрового широтно-імпульсного модулятора (ШИМ), що дозволяє підтримувати частоту обертання незмінною при збільшенні / зменшенні навантаження;
- 5) 8-ми ступінчате регулювання вихідної потужності п'єзоелектричного скелера і (або) діатермокоагулятора;
- 6) підсвітка інструментів з затримкою на вимикання (8÷10) сек;
- 7) запам'ятовування усіх кінцевих установок частоти обертання, крутного моменту, рівня потужності при вимиканні живлення;
- 8) візуальне відображення встановлених режимів стоматологічної установки в цілому, також індикація градацій частоти обертання, крутного моменту і рівня потужності;
- 9) звукове підтвердження натискання кнопки на пульті керування;
- 10) автоматичне обнуління в разі збою індикації на пульті блока лікаря або збою роботи контролера блока лікаря.

5.3.1. Настроювання частоти обертання мікромотора на II - IV робочому місці в нормальному режимі

1. Увімкніть живлення стоматологічної установки. При цьому на блоці лікаря встановлюється нормальний режим роботи (див. Рисунок 5.3.1.1).

2. Зніміть мікромотор з II - IV робочого місця блоку лікаря.

3. За допомогою кнопок  і  на пульті блоку лікаря встановіть максимальну частоту обертання мікромотора.

Кнопкою  частота обертання збільшується, а кнопкою  частота обертання зменшується.

Кожний індикатор блоку лікаря відображає певну градацію і відповідає заданій частоті обертання мікромотора (згідно таблиці 5.3.1.).

Наприклад, I-градація - світить один індикатор - обороти мікромотора ~ 3700 об/хв.

VIII-градація - світить вісім індикаторів - обороти мікромотора ~ 42000 об/хв.

4. Натисніть повзунок педалі і плавно переміщайте вліво-вправо відповідно для зменшення або збільшення частоти обертання мікромотора. При цьому максимальна частота обертання не перевищує значення, відповідне для вибраної градації.

В випадку ступінчатого регулювання частоти обертання кнопками ,  повзунок педалі повинен бути в крайньому правому положенні.

5. Для запам'ятовування встановлених частоти обертання та відповідної індикації покладіть інструмент.

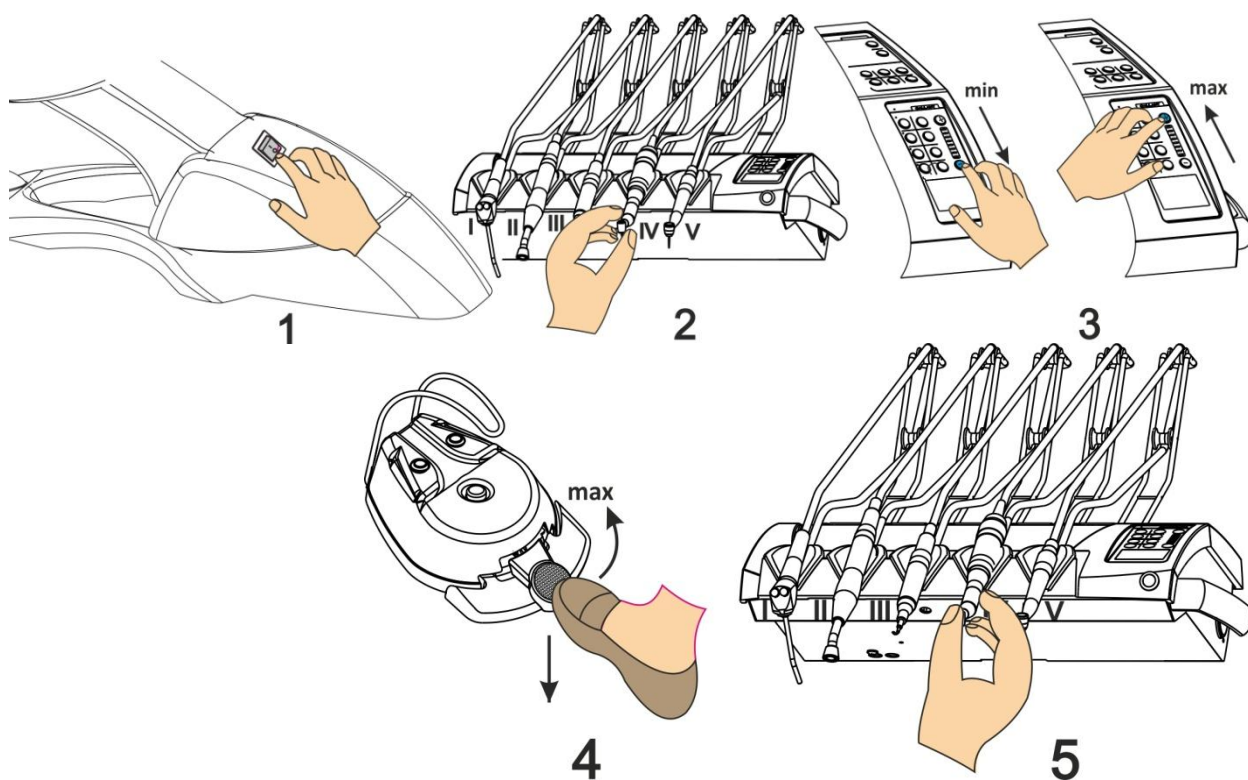


Рисунок 5.3.1.1 Настроювання частоти обертання мікромотора в нормальному режимі

5.3.2. Настроювання частоти обертання мікромотора в режимі ЕНДО

1. Зніміть мікромотор з третього робочого місця блоку лікаря (див. Рисунок 5.3.2.1).

2. Натисніть кнопку вмикання режиму ЕНДО, при цьому миготить індикатор який означає встановлення даного режиму.

3. За допомогою кнопок  і  на пульті блоку лікаря встановіть частоту обертання мікромотора.

Кнопкою  частота обертання збільшується, а кнопкою  частота обертання зменшується.

Кожний індикатор блоку лікаря відображає певну градацію і відповідає заданій частоті обертання мікромотора (згідно таблиці 5.3.1.).

Наприклад, I-градація - світить один індикатор - обороти мікромотора ~ 870 об/хв.

VIII-градація - світить вісім індикаторів - обороти мікромотора ~ 2900 об/хв.

4. Натисніть повзунок педалі і плавно переміщайте вліво-вправо відповідно для зменшення або збільшення частоти обертання мікромотора. При цьому максимальна частота обертання не перевищує значення, відповідне для вибраної градації.

В випадку ступінчатого регулювання частоти обертання кнопками ,  повзунок педалі повинен бути в крайньому правому положенні.

5. Для запам'ятовування встановлених частоти обертання та відповідної індикації покладіть інструмент.

6. Вимикання режиму ЕНДО здійснюється повторним натисканням кнопки .

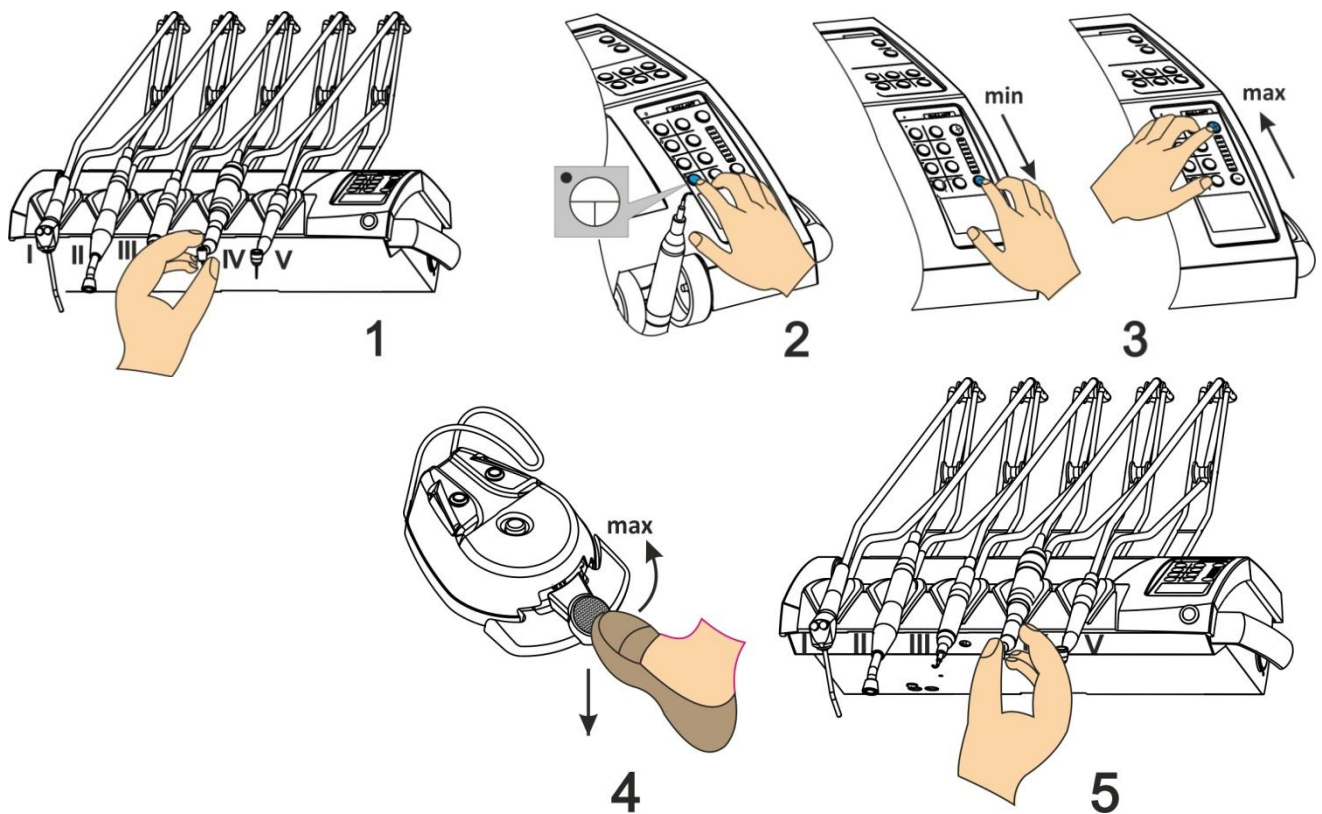


Рисунок 5.3.2.1 Настроювання частоти обертання мікромотора в режимі ЕНДО

*Примітка.

1. Другий мікромотор в режимі ЕНДО не працює.
2. Мікромотори MX, MX2 в комплекті OPTIMA MX INT або OPTIMA MX2 INT настраюються з пульта керування OPTIMA.
3. Мікромотори MX2, MSX без пульта керування OPTIMA в режимі ЕНДО також не працюють.

5.3.3. Настроювання крутного моменту мікромотора на III робочому місці в режимі ЕНДО

1. Натисніть кнопку вмикання режиму ЕНДО, при цьому миготить індикатор який означає встановлення даного режиму (див. Рисунок 5.3.3.1).
2. Повторно натисніть кнопку ЕНДО на час близько 5сек і дочекайтесь миготіння 8-ми вертикально розміщених світодіодів.

***Примітка.** Якщо встановлено мінімальний момент, то жоден з 8-ми світодіодів не миготітиме.

3. За допомогою кнопок  і  на пульті керування виберіть значення крутного моменту, при якому ендодофайл, наткнувшись за реальних умов на міцнішу перешкоду і досягнувши вибраного зусилля, призведе до перемикавання мікромотора з прямого руху у реверсивний. Усунення перешкоди автоматично повертає мікромотор у прямий рух.

Кнопкою  момент збільшується, а кнопкою  момент зменшується.

Для нормального режиму максимальний крутний момент 2,3 Н·см.

Для режиму ЕНДО кожний індикатор блоку лікаря відображає певну градацію і відповідає фіксованому значенню крутного моменту (згідно таблиці 5.3.2.).

Наприклад, I-градація - світить один індикатор – крутний момент $\sim 0,3$ Н·см.

VIII-градація - світить вісім індикаторів - крутний момент $\sim 2,3$ Н·см.

***Примітка.** Будь-які інші операції на стоматологічній установці в цей час є неможливі. Мікромотор також не обертається.

4. Натисніть ще раз кнопку ЕНДО для запам'ятовування значення крутного моменту. При цьому встановлюється нормальний режим роботи стоматологічної установки. Індикатор ЕНДО не миготить.

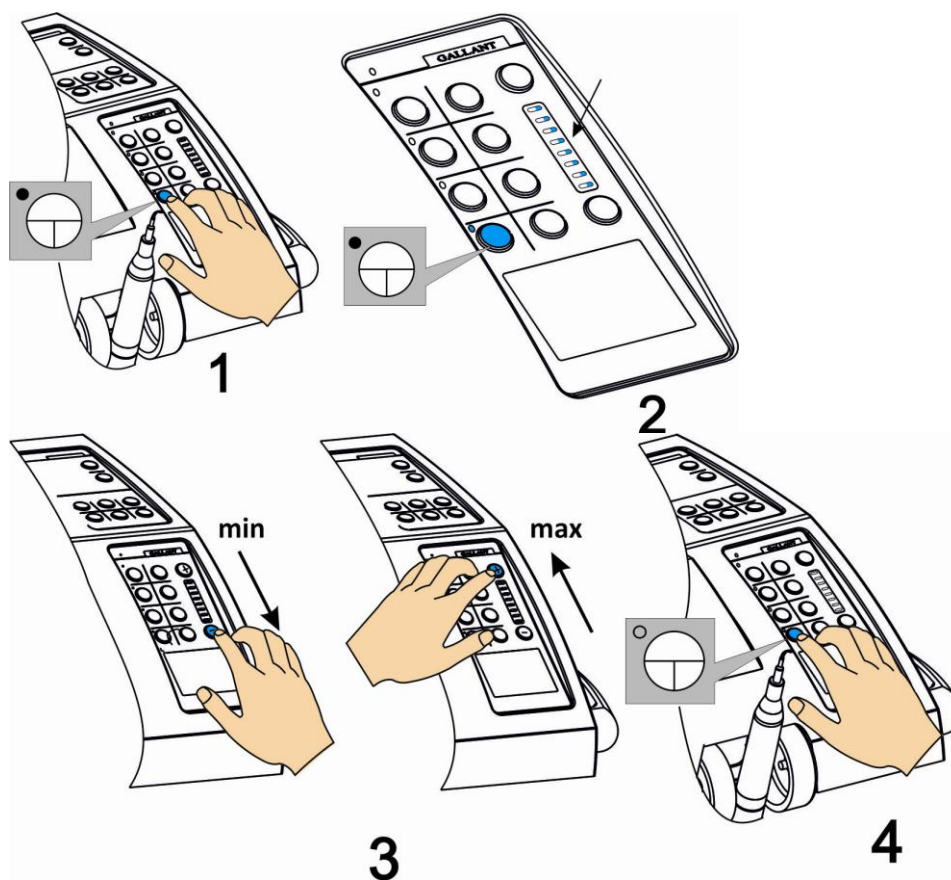


Рисунок 5.3.3.1 Настроювання крутного моменту мікромотора в режимі ЕНДО

Для включення пиле- і слиновідсмоктувача Durr COMFORT потрібно зняти інструмент з тримача. Одноразові наконечники слиновідсмоктувача в комплект не входять. Стоматологічна установка укомплектована блоком пилевідсмоктувача і слиновідсмоктувача, які працюють лише з агрегатом швидкісного відсмоктування (Рисунок 6.1.).



Рисунок 6.1.

7.1. Функції наповнення склянки і змиву плювальниці

Рисунок 7.1.1

❶ - Наповнення склянки.

❷ - Змив плювальниці.

❸ - Плювальниця.

Функції наповнення склянки водою і змив чаші плювальниці включаються натисненням відповідних кнопок на пульті керування лікаря:

- під час натискання кнопки наповнення склянки  на пульті блоку інструментів лікаря - вода поступає в склянку протягом 3-х сек. або доти, поки натиснута кнопка керування. При повторному натисненні кнопки пульта керування раніше 3 сек. подача води в склянку припиняється;
- під час натискання кнопки змиву чаші  на пульті блоку інструментів лікаря – відбувається змив чаші приблизно 10÷12 сек. або доти, поки натиснена кнопка керування. При повторному натисненні кнопки пульта керування раніше (10-12) сек. змив чаші припиняється.



Не виливати рідини в плювальницю, коли установка вимкнена.

7.2. Система чистої води

❶ перемикач подачі повітря в систему чистої води.

❷ перемикач подачі води СЧВ(система чистої води)/центральне водопостачання.

❸ ємність для води.

Заправка системи чистої води:

- вимкнути перемикач подачі повітря ❶ в систему чистої води;
- відкрутити ємність для води ❸;
- залити в ємність дистильовану воду;
- герметично закрутити в тримач ємність з водою; ввімкнути перемикач подачі повітря в систему чистої води (верхнє положення перемикача).

Рисунок 7.2.1.



УВАГА! З метою запобігання забруднення каналів гідросистеми установки і гідросистеми інструментів, заправку ємності здійснювати тільки дистильованою водою. Наявність безперервного шипіння навколо горловини ємності з водою свідчить про негерметичність. Для усунення негерметичності докрутити ємність, або замінити прокладку.



Для дезінфекції системи чистої води необхідно використовувати засіб FD 322 фірми "Durr Dental GmbH & Co. KG", або використовувати одноразові бутылки.

8.1. Очистка і дезінфекція установки

УВАГА! Роботи по обслуговуванню виконувати після вимикання обладнання.

Матеріали, з яких виготовлена установка, забезпечують зручну і легку очистку і дезінфекцію. Використовувати тільки м'яку тканину, змочену очищуючим або дезінфікуючим розчином.



УВАГА! Забороняється наносити і розпилювати розчин безпосередньо на поверхню установки, щоб запобігти попаданню всередину.

Для ефективної очистки і дезінфекції стоматологічного обладнання, в тому числі від збудників туберкульозу, грибків роду *Candida*, патогенних дерматофітів і плісневих грибків, складних вірусів ВІЧ, вірусів гепатиту, необхідно застосовувати спеціальні засоби фірми "Durr Dental GmbH & Co. KG". Ці засоби зареєстровані в Україні і дозволені для використання.



Детальні рекомендації щодо дезінфекції і очистки за допомогою препаратів фірми Durr Dental наведені в "Методичних вказівках".

для дезінфекції зовнішніх поверхонь установки

FD 312
FD 322



для дезінфекції і очистки відсмоктуючих систем:

Orotol Plus



Детальні рекомендації щодо роботи і обслуговування блоку асистента Durr Comfort наведені в інструкції на виріб.

8.2. Догляд за інструментами

Постійний догляд необхідний для бездоганного функціонування кожного інструменту. Це простий догляд і забезпечується спеціальними засобами. Змащення і підтримання в робочому стані інструментів повинні проводитись разом з очищенням, дезінфекцією і стерилізацією.



Для кожного конкретного інструменту необхідно використовувати ті засоби і рекомендації, які вказані в паспорті (інструкції) на цей інструмент. Використання інших засобів, не вказаних в паспорті(інструкції) або непогоджених з фірмою "Галіт", анулює гарантію на цей інструмент.


Засоби фірми Bien-Air для догляду за інструментами:

Очистка



Spraynet (шифр для замовлення REF 1600036-006) аерозоль з очищаючим засобом для інструментів і приладів. Рекомендується застосовувати перед стерилізацією. Розчиняє і виполіскує навіть сильне забруднення. Для очищення і догляду за шлангами, кабелями і поверхнями приладів, а також електричних мікромоторів рекомендується використовувати салфетку, добре змочену очищаючим засобом Spraynet. Аерозоль Spraynet придатний для очистки всіх турбін, прямих і кутових наконечників, а також повітряних моторів і електричних мікромоторів без кутових щіток. Всі інструменти, очищені зсередини засобом Spraynet, повинні бути змащені перед стерилізацією і зберіганням.

Змазка

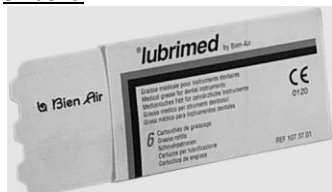

Lubrimed (шифр для замовлення REF 1600037-006) медична консистентна змазка для підшипникових турбін. Змащування головки турбіни проводиться змащувальним інструментом Lubrimed (шифр для замовлення REF 1000003-001). Змащувати інструменти необхідно перед кожною стерилізацією або мінімум два рази на день.

Змазка



Lubrifluid (шифр для замовлення REF 1600064-006) – аерозоль для змащування кутових наконечників, повітряних моторів і електричних мікромоторів.

Стерилізація


- в автоклаві до 136°C / 2,2 бар на протязі 10-30 хвилин;
- оксидом етилену при 60°C;
- цикл сушки: максимум 136°C на протязі максимум 30 хвилин.



Детальні рекомендації і правила догляду за інструментами вказані в паспорті (інструкції) на цей інструмент.

Детальні рекомендації щодо використання засобів догляду за інструментами вказані в інструкції по використанню цих засобів.

8.3. Очистка фільтру плювальниці

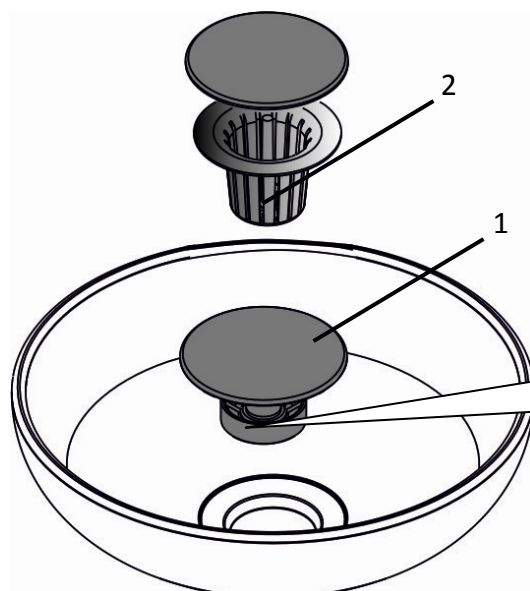

Зняти фільтр плювальниці **поз.1** і очистити його, або використовувати фільтри плювальниці (VCF-353-02) **поз.2** з комплекту поставки.

Рисунок 8.3.1.

8.4. Злив конденсату з установки

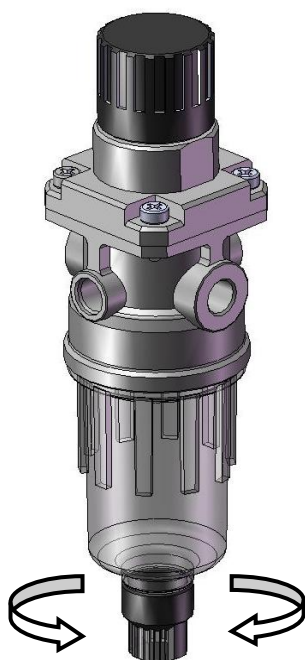


Рисунок 8.4.1.

При зменшенні тиску повітря в системі установки менше 1 бара відкривається клапан фільтру тонкого очищення повітря і конденсат, який збирається в ємності цього фільтру, зливається. За необхідністю злив конденсату дозволяється проводити примусово, для цього:

- підкладіть ємність для зливу конденсату під шланг;
- клапан фільтру підняти догори;
- повністю злити конденсат;
- клапан фільтру повернути (Рисунок 8.4.1).

Шифри фільтруючих елементів для замовлення:

Тонкість фільтрації	Шифр
25 мкм	C104-F20/3 Camozzi
5 мкм	C104-F21/3 Camozzi
0,01 мкм	C104-F26 Camozzi

8.5. Очистка фільтра відпрацьованого повітря пневмовиходів

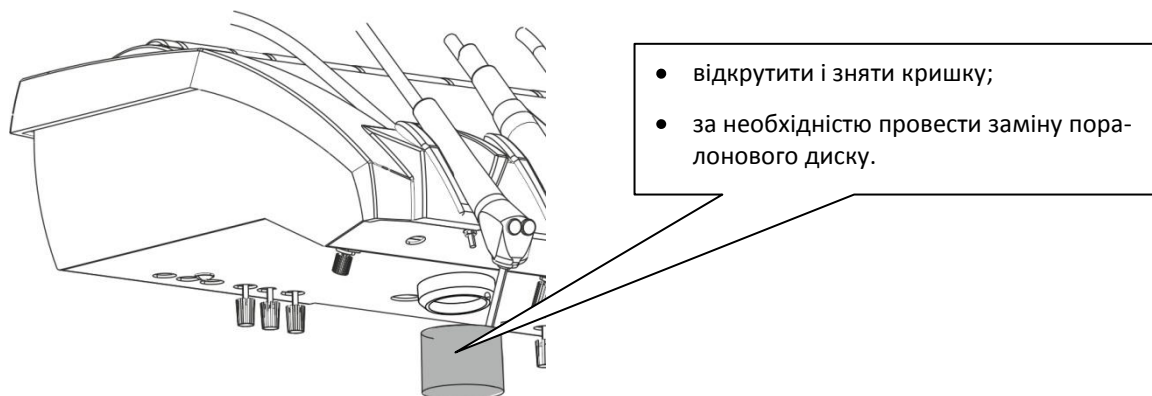


Рисунок 8.5.1.

8.6. Фільтр грубої очистки

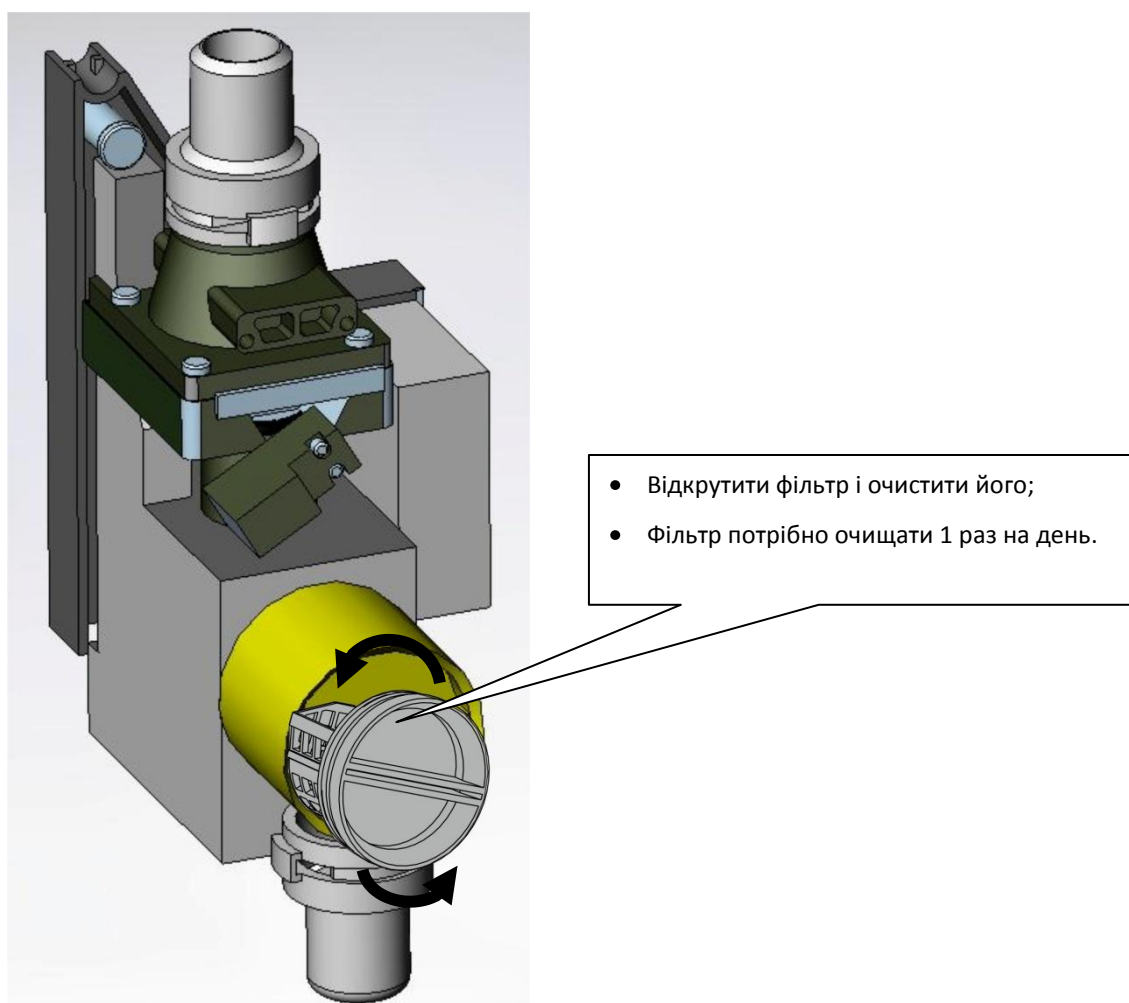


Рисунок 8.6.1

8.7. Обслуговування аспірації блоку асистента

До системи аспірації належать:

- термінали слино- та пилевідсмоктувача (частини, куди встановлюються одноразові трубки слиновідсмоктувача та пилевідсмоктувача);
- шланги слино- та пилевідсмоктувача (Рисунок 8.7.1.);
- з'єднуючі шланги системи;
- фільтр (Рисунок 8.7.2.) в корпусі.

Для одночасної дезинфекції, очистки, дезодорування і догляду за відсмоктуючими стоматологічними системами необхідно використовувати засоби "Durr Dental GmbH & Co. KG" Orotol-Plus. Робочі розчини цих препаратів здійснюють автоматичну тривалу і безпечну очистку. При щоденному використанні вони забезпечують технічний і гігієнічний рівень роботи відсмоктуючих стоматологічних систем навіть за наявності високої контамінації мікробами і значними забрудненнями (слина, амальгамний і зубний пил, кров, т.д.). У відповідності з інтенсивністю роботи відсмоктуючої стоматологічної системи дезинфекцію і очистку проводять 1-2 рази на день.

Важливо після прийому **кожного пацієнта** протягнути через шланг слино та пилевідсмоктувача 1 літр води, шляхом занурення терміналів слино та пилевідсмоктувача в ємність з 1 л чистої водопровідної води.

8.7.1. Очищення вхідного фільтра

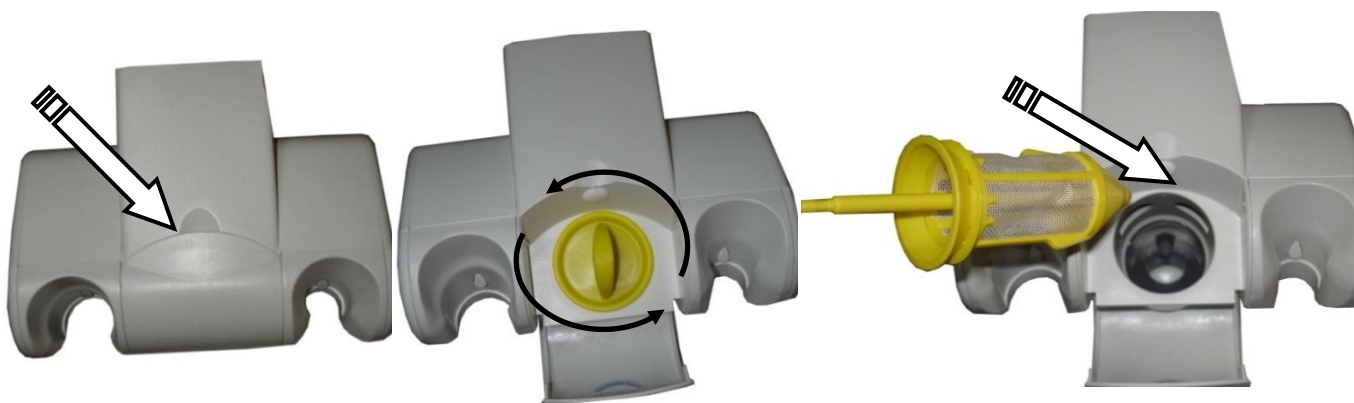


Рисунок 8.7.1

Один раз в день необхідно:

- Відкрити кришку фільтра аспіраційного блоку, потягнувши її на себе (Рисунок 8.7.1);
 - Витягнути фільтр 0725-040-00 (Рисунок 8.7.2.);
 - Промити фільтр, використовуючи засоби "Durr Dental GmbH & Co. KG" OROTOL-Plus або нейтральні миючі засоби;
 - Скласти у зворотньому порядку фільтр аспіраційного блоку.
- Фільтр потрібно очищувати не менше **1 раз на день**.

Примітка! Частки амальгами з вхідного фільтра (0725-040-00) поштати в окрему ємність і здати в пункт прийому сировини.



Рисунок 8.7.2



УВАГА! Виробник гарантує надійну роботу відсмоктуючих стоматологічних систем тільки при використанні засобів "Durr Dental GmbH & Co. KG" OROTOL-Plus.

Застосування піноутворюючих миючих засобів для очистки і дезинфекції відсмоктуючих стоматологічних систем категорично забороняється.



Рисунок 8.7.3

Робочий розчин **Orotol-Plus** готують шляхом розведення 20 мл концентрату в 1 л холодної води.

При використанні препарату "**OroCup**" фірми "Durr Dental GmbH & Co. KG" (шифр для замовлення 0780-350-00) процедура дезинфекції становить 4 хвилини

Детальні вказівки щодо використання засобів "Durr Dental GmbH & Co. KG" наведені в методичних вказівках на ці засоби.

8.8. Заміна запобіжників



УВАГА! Перед тим, як замінити запобіжники, виключіть установку : відключіть від електромережі, виключіть головний вмикач, поверніть ручки кранів подачі повітря і води в установку в положення ЗАКРИТО.

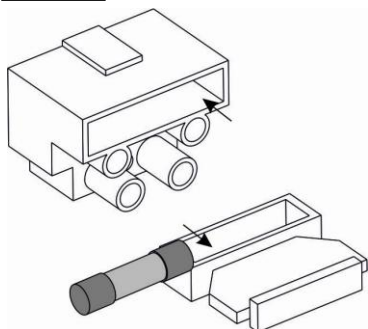


Рисунок 8.8.1

Позначення і технічні характеристики вставок плавких

Позначення	Значення	Струм спрацьовування	Захист	Розміщення в установці
Вставка плавка F1	T 6,3 AL	17A / 100мс	Загальна шина (0В)	Гідроблок. Плата A120/6.1
Вставка плавка F2	T 2 AL	5,4A / 100мс	~18В (живлення клапанів гідроблоку)	Гідроблок. Плата A120/6.1
Вставка плавка F3	T 6,3 AL	17A / 100мс	~27В (живлення блоку лікаря)	Гідроблок. Плата A120/6.1
Вставка плавка F4	T 6,3 AL	17A / 100мс	~24В (живлення блоку лікаря)	Гідроблок. Плата A120/6.1
Вставка плавка F6	T 6,3 AL	17A / 100мс	~24В (для додаткових пристроїв)	Гідроблок. Плата A120/6.1
Вставка плавка F1 (X1)	T 4 AL	10,8A / 100мс	Мережа ~220В	Гідроблок
Вставка плавка F2 (X2)	T 4 AL	10,8A / 100мс	Мережа ~220В	Гідроблок
Вставка плавка	2 x T 6,3A	17A / 100мс		В основі крісла (див. настанову щодо експлуатування крісла ECO19/STING.)

Плата A120/6.1 контролера гідроблоку

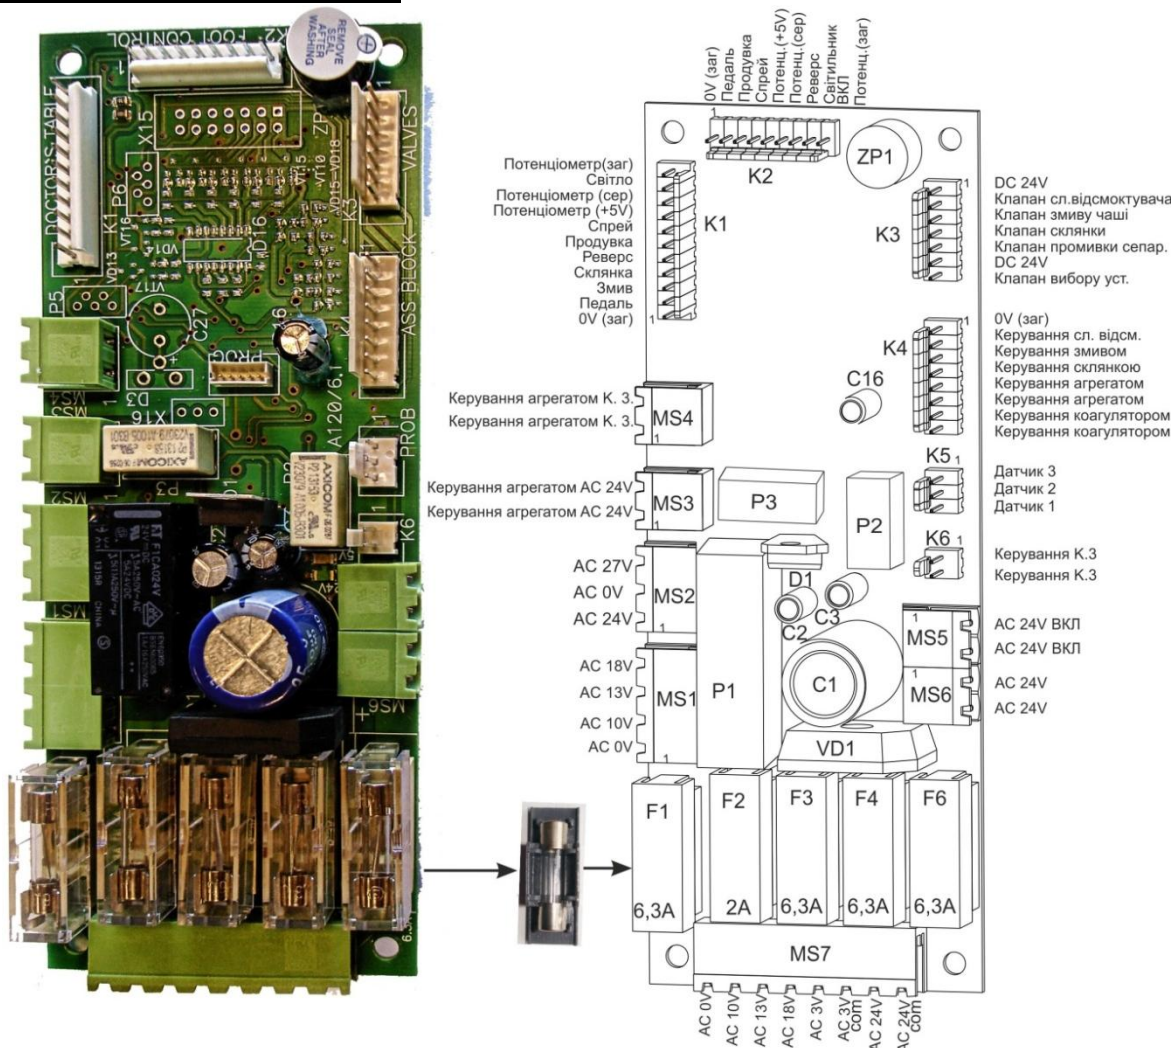


Рисунок 8.8.2

Вузли	Періодичність
• фільтр чаші плювальниці гідроблоку.	Після прийому пацієнта.
• фільтр відпрацьованого повітря пневмовиходу.	Раз в місяць.
• Злив конденсату.	в кінці роботи.
• Фільтр слиновідсмоктувача.	в кінці роботи.
• Шланги пиле- и слиновідсмоктувачів.	в кінці роботи.
• Турбінні наконечники (стерилізація, очищення і змащення).	після прийому пацієнта.
• Електричні мікромоторні наконечники (стерилізація, очищення і змащення).	після прийому пацієнта.
• Електричний мікромотор (дезинфекція зовнішніх поверхонь).	після прийому пацієнта.
• П'єзоскелер (стерилізація або дезинфекція зовнішніх поверхонь).	після прийому пацієнта.
• Стоматологічний пістолет (стерилізація або дезинфекція зовнішніх поверхонь).	після прийому пацієнта.
• Очистка і дезинфекція зовнішніх поверхонь установки.	в кінці роботи.



УВАГА! Перед проведенням робіт по усуненню несправностей відключити установку від електромережі : вимкнути головний вмикач.

Несправність	Причина	Спосіб усунення
Відсутня світлова індикація при ввімкненому положенні вимикача.	Відсутня напруга в електромережі.	Перевірити наявність напруги в електромережі.
	Перегоріли вставки плавкі.	Замінити вставки плавкі.
Не працює слиновідсмоктувач (водяний).	Недостатній тиск в системі водопостачання.	Перевірити тиск в системі водопостачання.
	Забитий зовнішній фільтр води.	Промити зовнішній фільтр води.
Пропускання повітря або води.	Порушена герметичність з'єднань.	Усунути негерметичність.
Відсутня подача води через стоматологічний пістолет.	Забитий канал наконечника пістолету.	Прочистити канал подачі води наконечника мандреном з комплекту поставки турбінного наконечника.

Важливі робочі характеристики при перевірці на ЕМС

№	Перевірка функціонування	Нормативні дані
1.	Перевірка регулювання частоти обертання інструмента з мікромотором, об/хв.	Перевіряється функція “регулюється / не регулюється”
2.	Перевірка регулювання частоти обертання інструмента пневмотурбіни, об/хв.	Перевіряється функція “регулюється / не регулюється”
3.	Включення реверсу, спрея, негатоскопа, світильника	Перевіряється функція “включається / не включається”
4.	Перевірка роботи стоматологічного пістолету	Перевіряється функція “включається / не включається”

Місця установки “Gallant AMBIDEXTRE”, чутливі до електростатичного розряду, промарковані попереджувальними символами і надписами:



Забороняється дотикання до контактів з'єднань, які мають попереджувальний символ маркування про чутливість до електростатичного розряду.

Перед підключенням до даних з'єднань необхідно дотримуватись запобіжних заходів.

Керівництво і декларація виробника (електромагнітні випромінювання)			
Стоматологічна установка “Gallant AMBIDEXTRE” призначена для експлуатації у вказаному нижче електромагнітному середовищі. Замовник або користувач зобов'язаний забезпечити експлуатацію при наступних умовах зовнішнього середовища.			
	Випробування на випромінювання	Відповідність	Електромагнітне середовище (рекомендації)
	Випромінювання РЧ CISPR 11	Група 1	Стоматологічна установка “Gallant AMBIDEXTRE” використовує високочастотну енергію тільки для свого внутрішнього функціонування. Тому її високочастотне випромінювання є незначним, і навряд чи викличе будь-які завади в електричному обладнанні, яке знаходиться поряд.
	Випромінювання РЧ CISPR 11	Клас В	
	Гармонічні випромінювання МЕК 61000-3-2	Клас А	
	Коливання напруги/ флікер МЕК 61000-3-3	Відповідає	

Керівництво і декларація виробника. Електромагнітна завадостійкість			
Стоматологічна установка "Gallant AMBIDEXTRE" призначена для використання у вказаному нижче електромагнітному середовищі. Користувач стоматологічної установки "Gallant AMBIDEXTRE" зобов'язаний забезпечити експлуатацію в такому самому електромагнітному середовищі.			
Випробування на завадостійкість	Випробувальний рівень МЕК 60601	Рівень сумісності	Електромагнітне середовище (рекомендації)
Електростатичний розряд (ЕСР) МЕК 61000-4-2	±6 кВ, контактний розряд ±8 кВ, повітряний розряд	±6 кВ, контактний розряд ±8 кВ, повітряний розряд	Підлога повинна бути із дерева, бетону або керамічної плитки. Якщо підлога покрита синтетичним покриттям, то відносна вологість повинна бути не менше 30%.
Короточасні імпульсні завади МЕК 61000-4-4	±2 кВ для лінії живлення ±1 кВ для лінії входу/виходу	±2 кВ для лінії живлення ±1 кВ для лінії входу/виходу	Вимоги до електромережі як джерела живлення такі як для медичних приміщень.
Імпульсні завади великої енергії МЕК 61000-4-5	±1 кВ між лініями ±2 кВ між лініями і землею	±1 кВ між лініями ±2 кВ між лініями і землею	Вимоги до електромережі як джерела живлення такі як для медичних приміщень.
Спад напруги, короточасні переривання напруги і зміна напруги живлення мережі МЕК 61000-4-11	<5% U_T (спад напруги $U_T > 95\%$) на протязі 0,5 періода 40% U_T (спад напруги $U_T 60\%$) на протязі 5 періодів 70% U_T (спад напруги $U_T 30\%$) на протязі 25 періодів <5% U_T (спад напруги $U_T > 95\%$) на протязі 5 секунд	<5% U_T (спад напруги $U_T > 95\%$) на протязі 0,5 періода 40% U_T (спад напруги $U_T 60\%$) на протязі 5 періодів 70% U_T (спад напруги $U_T 30\%$) на протязі 25 періодів <5% U_T (спад напруги $U_T > 95\%$) на протязі 5 секунд	Вимоги до електромережі як джерела живлення такі як для медичних приміщень. Якщо потрібна безперебійна робота стоматологічної установки "Gallant AMBIDEXTRE" то при наявності переривань в мережі електроживлення, рекомендується здійснювати живлення стоматологічної установки "Gallant AMBIDEXTRE" від джерела безперебійного живлення або акумуляторів.
Магнітні поля з частотою мережі МЕК 61000-4-8	3 А/м	3 А/м	Вимоги до магнітного поля промислової частоти повинно відповідати величинам, встановленим для медичних приміщень.
*Примітка. U_T – зміна напруга мережі до застосування перевірного рівня.			

Керівництво і декларація виробника. Електромагнітна завадостійкість			
Стоматологічна установка "Gallant AMBIDEXTRE" призначена для використання в вказаному нижче електромагнітному середовищі. Користувач установки "Gallant AMBIDEXTRE" зобов'язаний забезпечити експлуатацію в такому самому електромагнітному середовищі.			
Випробування на завадостійкість	Випробувальний рівень МЕК 60601	Рівень відповідності	Електромагнітне середовище (рекомендації)
Кондуктивні радіозавади МЕК 61000-4-6 Випромінювальні радіозавади МЕК 61000-4-3	3 В (середньоквадратичне значення) від 150 кГц до 80 МГц, крім діапазонів ПНМ^а 3 В/м від 80 МГц до 2,5 ГГц	3 В 3 В/м	Відстань між використовуваним портативним або пересувним обладнанням РЧ зв'язку і будь-яким вузлом стоматологічної установки "Gallant AMBIDEXTRE", включаючи кабелі, повинно бути не менше рекомендованої мінімальної відстані, яка вираховується з формули для відповідної частини передавача. Рекомендована відстань: $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P} \text{ (від 80 МГц до 800 МГц)}$ $d = 2,3\sqrt{P} \text{ (від 800 МГц до 2,5 ГГц)}$ де P – це максимальна вихідна потужність передавача в ватах (Вт) згідно даних виробника передавача, а d – рекомендована відстань апаратури в метрах(м).^б Напруженість поля, створюваного стаціонарними радіопередавачами визначена електромагнітними дослідженнями,^а повинна бути менше, рівня сумісності в кожному частотному діапазоні.^б Завади можуть з'явитись поруч з апаратурою, відміченою наступним символом: 
*Примітка 1. На частотах 80 МГц і 800 МГц застосовується значення для верхнього діапазона частот. *Примітка 2. Дані рекомендації не застосовуються для всіх ситуацій. На поширення електромагнітних хвиль впливає поглинання і відображення, які вносяться конструкціями, предметами і людьми.			
^а Напруженість поля, створюваного стаціонарними передавачами, наприклад, базовими станціями радіотелефонного (мобільного/безпроводного) зв'язку, наземними пересувними радіостанціями, аматорськими радіостанціями, передавачами радіомовлення з АМ і ЧМ, а також передавачами телевізійного мовлення, теоретично неможливо точно передбачити. Для оцінки електромагнітного середовища, на яке впливають стаціонарні радіопередавачі, слід передбачити проведення дослідження електромагнітної завадостійкості на місці. Якщо виміряні значення напруженості поля на місці експлуатації стоматологічної установки "Gallant AMBIDEXTRE" перевищують вказаний вище рівень сумісності для даного випадку, то слід провести перевірку нормального функціонування стоматологічної установки "Gallant AMBIDEXTRE" на протязі деякого часу. Якщо будуть відхилення від нормального функціонування, то слід вжити додаткових заходів, наприклад, змінити розміщення стоматологічної установки "Gallant AMBIDEXTRE". ^б На всьому діапазоні частот від 150 кГц до 80 МГц напруженість поля повинна бути не менше 3 В/м.			

Рекомендована безпечна відстань між портативними і переносними пристроями радіозв'язку і обладнанням або системою

Стоматологічна установка "Gallant AMBIDEXTRE" призначена для використання в електромагнітному середовищі, в якому контролюються випромінювані радіозавади. Користувач стоматологічної установки "Gallant AMBIDEXTRE" може не враховувати електромагнітні завади, якщо буде дотримуватись мінімальної відстані між портативними і переносними пристроями радіозв'язку (радіопередавачів) і рекомендації нижче, у відповідності з максимальною вихідною потужністю апаратури радіозв'язку.

Нормована максимальна вихідна потужність передавача, Вт	Відстань в залежності від частоти передавача, м		
	Від 150 кГц до 80 МГц $d = 1,2\sqrt{P}$	Від 80 МГц до 800 МГц $d = 1,2\sqrt{P}$	Від 800 МГц до 2,5 ГГц $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,24
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,34
10	3,69	3,69	7,38
100	11,67	11,67	23,34

Для передавачів, максимальна вихідна потужність яких не перерахована вище, рекомендована відстань в метрах (м) може бути розрахована по формулі, яка застосовується до частоти передавача, де P це максимальна номінальна вихідна потужність передавача в ватах (Вт), яка вказується виробником цього радіопередавача.

***Примітка 1.** На частотах 80 МГц і 800 МГц застосовується більш високий діапазон частот.

*** Примітка 2.** Дані рекомендації не застосовуються для всіх ситуацій. На розповсюдження електромагнітних хвиль впливає поглинання і відображення їх від приміщень, предметів і людей.

Утилізація установок

Згідно директиви 2002/96/ЕС для запобігання забруднення навколишнього середовища та травм при утилізації дотримуйтеся законів про утилізацію.

Можливо, що установка заражена. Обов'язково повідомте про це підприємство, щоб прийняти відповідні заходи безпеки.



Незаражені пластмасові частини можливо передавати на поновлення пластмаси.

Електронні плати та електронні компоненти необхідно утилізувати як металобрухт електроніки.

Інші металеві частини (наприклад, корпус) необхідно утилізувати як металобрухт.

Інші компоненти установки можуть утилізуватися у відповідності з місцевими діючими інструкціями про утилізацію.

Якщо установка повністю не виведена з експлуатації зв'яжіться з виробником або продавцем цієї установки.

Додаток А. Перевірка параметрів стоматологічного обладнання

виріб	стоматологічна установка "Gallant AMBIDEXTRE"
серійний номер	
дата	

В інтересах безпеки персоналу та правильного функціонування обладнання необхідно щороку проводити перевірку стоматологічної установки по електробезпеці згідно стандарту ІЕС 60601-1-1.

Власник несе відповідальність за організацію даної перевірки, а також за забезпечення того, що технічні спеціалісти, які проводять перевірку обладнання по електробезпеці, є висококваліфікованими спеціалістами.

Таблиця 1

№	Параметр електробезпеки	Пункт стандарту ІЕС 60601-1-1	Нормативний показник	Наявний Показник (Заповнює представник ВТК)	Наявний Показник (Заповнює особа відповідальна за монтаж установки)
1.	Перевірка захисного уземлення, Ом	п. 8.6	< 0,2		
2.	Перевірка струму витоку на землю, мкА	п. 8.7.4.5	< 500		
3.	Перевірка струму витоку на пацієнта, мкА	п. 8.7.4.7	< 100		
4.	Перевірка електричної ізоляції	п. 8.8	Відп.		

Представник ВТК _____ (_____)

Особа, відповідальна за монтаж установки _____ (_____)

Для зручності, форма звіту про перевірку обладнання по електробезпеці наведена нижче:

через 1 рік

Дата перевірки	№	Параметр електробезпеки	Нормативний показник	Наявний показник	Підпис
	1	Перевірка захисного уземлення, Ом	< 0,2		
	2	Перевірка струму витоку на землю, мкА	< 500		
	3	Перевірка струму витоку на пацієнта, мкА	< 100		
	4	Перевірка електричної ізоляції	Відп.		

через 2 роки

Дата перевірки	№	Параметр електробезпеки	Нормативний показник	Наявний показник	Підпис
	1	Перевірка захисного уземлення, Ом	< 0,2		
	2	Перевірка струму витоку на землю, мкА	< 500		
	3	Перевірка струму витоку на пацієнта, мкА	< 100		
	4	Перевірка електричної ізоляції	Відп.		

через 3 роки

Дата перевірки	№	Параметр електробезпеки	Нормативний показник	Наявний показник	Підпис
	1	Перевірка захисного уземлення, Ом	< 0,2		
	2	Перевірка струму витоку на землю, мкА	< 500		
	3	Перевірка струму витоку на пацієнта, мкА	< 100		
	4	Перевірка електричної ізоляції	Відп.		

через 4 роки

Дата перевірки	№	Параметр електробезпеки	Нормативний показник	Наявний показник	Підпис
	1	Перевірка захисного уземлення, Ом	< 0,2		
	2	Перевірка струму витоку на землю, мкА	< 500		
	3	Перевірка струму витоку на пацієнта, мкА	< 100		
	4	Перевірка електричної ізоляції	Відп.		

через 5 років

Дата перевірки	№	Параметр електробезпеки	Нормативний показник	Наявний показник	Підпис
	1	Перевірка захисного уземлення, Ом	< 0,2		
	2	Перевірка струму витоку на землю, мкА	< 500		
	3	Перевірка струму витоку на пацієнта, мкА	< 100		
	4	Перевірка електричної ізоляції	Відп.		

через 6 років

Дата перевірки	№	Параметр електробезпеки	Нормативний показник	Наявний показник	Підпис
	1	Перевірка захисного уземлення, Ом	< 0,2		
	2	Перевірка струму витоку на землю, мкА	< 500		
	3	Перевірка струму витоку на пацієнта, мкА	< 100		
	4	Перевірка електричної ізоляції	Відп.		

через 7 років

Дата перевірки	№	Параметр електробезпеки	Нормативний показник	Наявний показник	Підпис
	1	Перевірка захисного уземлення, Ом	< 0,2		
	2	Перевірка струму витоку на землю, мкА	< 500		
	3	Перевірка струму витоку на пацієнта, мкА	< 100		
	4	Перевірка електричної ізоляції	Відп.		

через 8 років


Дата перевірки	№	Параметр електробезпеки	Нормативний показник	Наявний показник	Підпис
	1	Перевірка захисного уземлення, Ом	< 0,2		
	2	Перевірка струму витоку на землю, мкА	< 500		
	3	Перевірка струму витоку на пацієнта, мкА	< 100		
	4	Перевірка електричної ізоляції	Відп.		

через 9 років

Дата перевірки	№	Параметр електробезпеки	Нормативний показник	Наявний показник	Підпис
	1	Перевірка захисного уземлення, Ом	< 0,2		
	2	Перевірка струму витоку на землю, мкА	< 500		
	3	Перевірка струму витоку на пацієнта, мкА	< 100		
	4	Перевірка електричної ізоляції	Відп.		

через 10 років

Дата перевірки	№	Параметр електробезпеки	Нормативний показник	Наявний показник	Підпис
	1	Перевірка захисного уземлення, Ом	< 0,2		
	2	Перевірка струму витоку на землю, мкА	< 500		
	3	Перевірка струму витоку на пацієнта, мкА	< 100		
	4	Перевірка електричної ізоляції	Відп.		

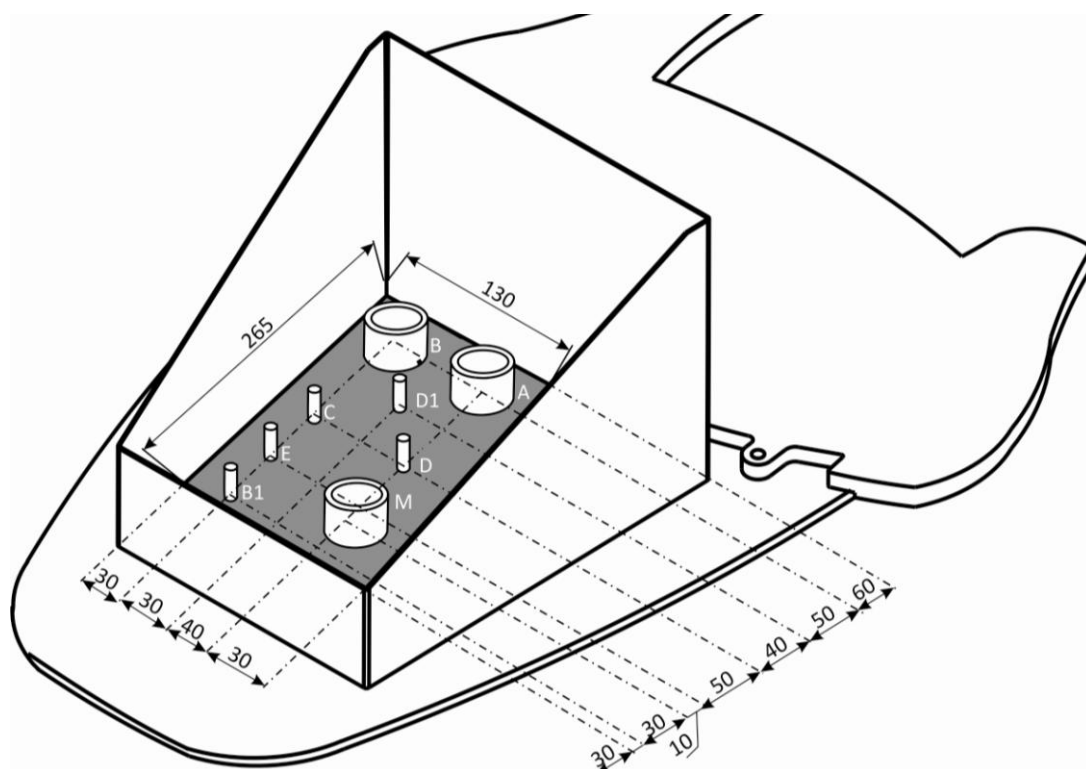

A	Під'єднання до каналізації	Пластикова труба $\varnothing=50$ мм (внутрішній) (DIN 50), висота на рівні підлоги або максимально (30÷50)мм.
B	Під'єднання до витяжного агрегату	Армований шланг або пластикова труба $\varnothing=50$ мм (внутрішній) (DIN50), висота на рівні підлоги або максимально (30÷ 50)мм, нахил не менше 2%. В місці встановлення агрегату забезпечити канал для виходу відпрацьованого повітря. Для детальних рекомендацій по проектуванню системи відсмоктування див. (Duerr Dental-Info-Suction-EN.pdf) of DURR DENTAL Company.
B1	Кабель керування витяжним агрегатом	Мідний кабель 2 x 1 мм ² до місця встановлення агрегату, протягнутий через гофрук: довжина вільних кінців 500-1000мм.
C	Підвід повітря	Мідна або пластикова труба, кран з внутрішньою різьбою ½ дюйма як можна ближче до рівня підлоги. Мінімальний тиск 8 бар. Кран можливо розмістити в іншому місці, при цьому магістраль закінчити внутрішньою різьбою ½ дюйма .
D	Підвід води	Мідна або пластикова труба, кран з внутрішньою різьбою ½ дюйма як можна ближче до рівня підлоги. Кран можливо розмістити в іншому місці, при цьому магістраль закінчити внутрішньою різьбою ½ дюйма .
D1	Підвід води – централізована система чистої води СЧВ (при необхідності)	Мідна або пластикова труба, кран з внутрішньою різьбою ½ дюйма як можна ближче до рівня підлоги. Кран можливо розмістити в іншому місці, при цьому магістраль закінчити внутрішньою різьбою ½ дюйма .
E	Під'єднання до мережі живлення	Вимоги до мережі: 220÷230/~50Гц, 900ВА мідний кабель, 3x1,5мм ² - захисний автомат 10А. Обов'язково виконати заземлення мережевого кабеля. Довжина вільних кінців 500мм. Рекомендовано встановити пристрій захисного від'єднання від мережі (дифреле), наприклад 5SM 1312 фірми “Siemens”.
M	Мультимедіа (при необхідності)	Пластикова труба або кабель-канал $\varnothing=50$ мм (внутрішній) (DIN50), з гладкою внутрішньою поверхнею до місця встановлення компютера, яка прокладена з мінімальними згинами. Згин більше 45° не допускається. Повинно забезпечуватись вільне прокладання VGA- кабеля разом з роз'ємом.

Порядок розміщення виводів не має значення. Не розміщувати виводи впритул, необхідно враховувати виконання з'єднань при монтажі. При спробі виконавця монтажних робіт змінити розміри (діаметри) необхідна консультація з постачальником, оскільки це може привести до неправильної роботи обладнання.

13. Загальні умови гарантії

1. ПП "ГАЛІТ" надає гарантію на вироби власного виробництва та вироби інших виробників, продані підприємством, протягом 24 місяці з дати монтажу, якщо інші терміни не вказані в супровідній документації на вироби.

2. Гарантійні послуги виконуються шляхом безкоштовного ремонту, або заміни дефектної деталі (вузла).

Вартість приїзду працівника сервісної служби (або технічного спеціаліста торгового представника) для виконання гарантійних зобов'язань є платною послугою згідно затверджених розцінок Сервісного центру ПП "ГАЛІТ". Рішення про метод виконання ремонту приймає сервісна служба ПП "ГАЛІТ" при умові, що дефекти викликані неякісним складанням, або неякісними матеріалами та комплектуючими виробами на протязі не більше 10 робочих днів від одержання Листка реєстрації несправностей. Термін може бути продовжений до 30 робочих днів, якщо несправність вимагає надсилання товару для ремонту або аналізу виникнення несправності на зарубіжну фірму виробника.

3. Необхідною умовою надання гарантійних послуг є наявність наступних документів:

- 1) даного, належним чином заповненого Гарантійного талона, який необхідно зберігати;
- 2) заповненого і зареєстрованого Відривного талону, який необхідно надіслати виробнику;
- 3) заповненого і завіреного Журналу обліку гарантійного ремонту, який необхідно висилати під час ремонту;

4. Приймання обладнання для виконання гарантійних послуг проводиться фірмою ГАЛІТ за адресою: ПП ГАЛІТ вул. 15 Квітня 6Є, с. Байківці, Тернопільський р-н, 47711, Україна.

5. Покупець власними силами або через регіональних представників ПП ГАЛІТ за власний кошт, забезпечує доставку дефектних деталей (вузлів) з Листком реєстрації несправностей за вищевказаною адресою. Дефектні деталі (вузли), які доставляються на ПП ГАЛІТ, обов'язково повинні бути продезинфікованими і простерилізовани (для виробів, які підлягають автоклавуванню). Дефектні деталі (вузли) повинні мати оригінальну упаковку, яка гарантує безпечну доставку до сервісного центру.

6. Прийняття рішення, чи підлягає дефектний компонент під дію гарантії, залишається за ПП "Галіт".

7. Виконання Гарантійних послуг для габаритного обладнання на місці встановлення забезпечують регіональні представники сервісної служби ПП ГАЛІТ, або технічні спеціалісти торгових представників, через яких обладнання було придбано. Умовою виїзду технічного спеціаліста на місце встановлення обладнання є належним чином заповнений і завірений Листок реєстрації несправностей та надісланий на адресу регіонального представника ПП "Галіт".

8. Гарантія не поширюється на:

- вироби з пошкодженими контрольними пломбами, які запобігають самовільному втручанню.
- вироби пошкоджені при транспортуванні або зберіганні;
- вироби, в яких проведене самовільне втручання або самовільні доробки;
- вироби, в яких виникли недоліки, викликані порушенням вказівок по експлуатації;
- вироби, в разі невиконання вимог по догляду і обслуговуванню згідно настанови щодо експлуатування (в тому числі щодо матеріалів, які використовуються, і періодичності виконання регламентних робіт), або інших супровідних документів;
- недоліки в роботі виробів і дефекти, викликані невідповідністю вимогам супровідних документів щодо мереж стисненого повітря, зливу (каналізації), електро- і водопостачання;
- деталі і вузли, дефекти яких спричинені природнім зносом, механічними пошкодженнями або дією хімічних засобів, не передбачених супровідними документами, в процесі експлуатації;
- лампочки світильників, мікромоторів, наконечників, турбін і інших інструментів.
- лампи безтіньових та хірургічних світильників.
- всі типи електричних вставок плавких.
- насадки пневмо- та ультразвукових скелерів.
- світлодіоди фотополімеризаційних ламп та світильників .

9. Гарантійні умови не передбачають періодичне технічне обслуговування і регламентні роботи, які користувач обладнання має виконувати самостійно згідно з інструкціями з експлуатації на вироби

10. При необґрунтованому зверненні за гарантійним обслуговуванням Покупець зобов'язаний компенсувати всі витрати ПП “Галіт” (або торгового представника), пов’язані з приїздом технічного працівника, згідно затверджених розцінок Сервісного центру. В разі відмови Покупця від компенсації Гарантія з даного виробу знімається. Рішення про обґрунтованість звернення приймає ПП “Галіт” (або його торговий представник).

Виробник :

Адреса:

Телефон:

30938037

(0352) 43 38 07

Дійсний після заповнення

Заповнює підприємство-виробник

Стоматологічне
обладнання

Модель

заводський №

Дата виготовлення

Представник ВТК підприємства-виробника

(штамп ВТК)

Адреса для подання претензій до якості роботи :

ПП "ГАЛІТ" вул. 15 Квітня 6Є, с. Байківці, Тернопільський р-н, 47711, Україна
тел. (0352) 43 38 07

Заповнює торгівельне підприємство

Дата продажу

(число, місяць, рік)

Продавец

(підпис або штамп)

Штамп магазину

Заповнює виконавець гарантійного обслуговування	
Назва підприємства-виконавця гарантійного обслуговування	
Адреса підприємства-виконавця гарантійного обслуговування	
Число, назва місяця, рік прийняття на гарантійне обслуговування	
Номер, під яким стоматологічну установку взято на гарантійний облік	

[illegible]

Гарантійний термін експлуатації продовжено

до _____ 20__ г.

до _____ 20__ г.

до _____ 20__ г.

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

(підпис)

ЖУРНАЛ обліку гарантійного ремонту (обслуговування)

Дата і підпис споживача про одержання то- вару після ремо- нту	Термін закінчен- ня ремонту	Зауваження ви- конавця під час приймання то- вару на ремонт	Характер недо- ліків	Найменування і заводський но- мер товару. За- водський номер комплектуючого виробу, складо- вої частини	Прізвище, ім'я та по батькові, ад- реса, номер те- лефону спожив- вача	Дата взяття на облік	Номер, за яким товар взято на гарантійний об- лік

Номер, за яким товар взято на гарантійний об- лік	Дата взяття на облік	Прізвище, ім'я та по батькові, ад- реса, номер те- лефону споживача	Найменування і заводський номер товару. Заводський номер комплектуючого виробу, складової частини	Характер недоліків	Зауваження виконавця під час приймання товару на ремонт	Термін закінчення ремонту	Дата і підпис споживача про одержання товару після ремонту

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН на введення в експлуатацію протягом 24 місяці гарантійного терміну експлуатаціїДійсний після заповнення

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН на введення в експлуатацію стоматологічної установки "Gallant AMBIDEXTRE" повинен бути відправлений на адресу фірми "Галіт" протягом 10 днів з моменту монтажу.

=====

Регіональний представник	
Користувач установки	
Стоматологічна установка "Gallant AMBIDEXTRE"	
Модель	
Зав. №	
Дата виготовлення	
Дата введення в експлуатацію установки	
Адреса місця знаходження установки:	
Поштовий код міста	
Місто	
Вулиця	
Будинок	
Квартира (Офіс)	
Підпис і П.І.Б. особи або сервісної служби, що здійснила монтаж і підключення установки	
Контактний телефон	
Підпис і П.І.Б. власника установки на підтвердження введення в експлуатацію установки	
Контактний телефон	

=====

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН на введення в експлуатацію СТОМАТОЛОГІЧНОЇ УСТАНОВКИ "Gallant AMBIDEXTRE"
(Зворотна сторона)

Склад установки

НАЗВА КОМПЛЕКТУЮЧИХ	ЗАВОДСЬКИЙ НОМЕР
Педаль	
Світильник	
Мікромотор	
Мікромотор	
Мікромотор	
Пістолет	
Фотополімерна лампа	
Коагулятор	
Скелер	
Сепаратор	
Нагрівач гідроблоку	
Нагрівач блоку лікаря	
Монітор	
Камера	

Особа, відповідальна за виконання упаковки _____ (_____)

Представник ВТК _____ (_____)